

Keysight U1731C/U1732C/ U1733C Handheld-LCR-Messgerät



dataTec

Mess- und Prüftechnik. Die Experten.

**Ihr Ansprechpartner /
Your Partner:**

dataTec AG

E-Mail: info@datatec.eu

>>> www.datatec.eu

Benutzerhandbuch

 **KEYSIGHT**
TECHNOLOGIES

Premium Plus Distribution Partner

Hinweise

Copyright

© Keysight Technologies 2011-2017
Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendwelcher Form oder mit irgendwelchen Mitteln (einschließlich Speicherung und Abruf auf elektronischem Wege sowie Übersetzung in eine fremde Sprache) ohne vorherige Zustimmung und schriftliche Einwilligung von Keysight Technologies gemäß der Urheberrechtsgesetzgebung in den USA und international reproduziert werden.

Handbuchteilenummer

U1731-90078

Ausgabe

Auflage 7, 1. Juli 2017

Gedruckt in:

Gedruckt in Malaysia

Veröffentlicht von:

Keysight Technologies
Bayan Lepas Free Industrial Zone,
11900 Penang, Malaysia

Technozielizenzen

Die in diesem Dokument beschriebene Hardware und/oder Software wird unter einer Lizenz geliefert und darf nur entsprechend den Lizenzbedingungen genutzt oder kopiert werden.

Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärungen für dieses Produkt und andere Keysight Produkte können im Internet heruntergeladen werden. Gehen Sie zu <http://www.keysight.com/go/conformity>. Dann können Sie mithilfe der Produktnummer die aktuelle Konformitätserklärung suchen.

U.S. Government Rights (eingeschränkte Rechte der US-Regierung)

Die Software ist „kommerzielle Computersoftware“ gemäß Definition in der Federal Acquisition Regulation („FAR“) 2.101. Gemäß FAR 12.212 und 27.405-3 sowie Department of Defense FAR Supplement („DFARS“) 227.7202 erwirbt die US-Regierung kommerzielle Computersoftware unter denselben Bedingungen, unter denen die Software üblicherweise öffentlich verkauft wird. Demzufolge stellt Keysight die Software US-Regierungskunden mit einer standardmäßigen kommerziellen Lizenz zur Verfügung, die in der Endbenutzerlizenzvereinbarung (EULA) beschrieben ist, deren Kopie Sie unter <http://www.keysight.com/find/sweula> finden. Die in der EULA beschriebene Lizenz stellt die exklusive Berechtigung dar, der zufolge die US-Regierung die Software nutzen, ändern, verteilen oder offen legen darf. Die EULA und die darin beschriebene Lizenz verlangen bzw. erlauben unter anderem nicht, dass Keysight: (1) technische Informationen zu kommerzieller Computersoftware bzw. Dokumentation zu kommerzieller Computersoftware bereitstellt, die üblicherweise nicht öffentlich bereitgestellt werden; oder (2) Rechte an die Regierung abtritt oder der Regierung anderweitig einräumt, die diese üblicherweise öffentlich bereitgestellten Rechte zum Nutzen, Ändern, Reproduzieren, Freigeben, Ausführen, Anzeigen oder Offenlegen von kommerzieller Computersoftware bzw. Dokumentation zu kommerzieller Computersoftware übertreffen. Es gelten keine Anforderungen der Regierung, die über die in der EULA ausgeführten Anforderungen hinausgehen, ausgenommen in dem Umfang, in dem solche Bedingungen, Rechte oder Lizenzen explizit von allen Anbietern kommerzieller Computersoftware gemäß FAR und DFARS verlangt werden und ausdrücklich schriftlich an anderer Stelle in der EULA ausgeführt sind. Keysight ist nicht zu Aktualisierung, Überarbeitung oder sonstiger Änderung der Software verpflichtet. Hinsichtlich beliebiger technischer Daten laut Definition in FAR 2.101, gemäß FAR 12.211 und 27.404.2 und DFARS 227.7102, erwirbt die US-Regierung keine weitergehenden Rechte als die begrenzten Rechte laut Definition in FAR 27.401 oder DFAR 227.7103-5 (c), wie für beliebige technische Daten geltend.

Garantie

DAS IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENE MATERIAL WIRD IM VORLIEGENDEN ZUSTAND ZUR VERFÜGUNG GESTELLT UND KANN IN ZUKÜNFTIGEN AUSGABEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. DARÜBER HINAUS ÜBERNIMMT KEYSIGHT IM GESETZLICH MAXIMAL ZULÄSSIGEN RAHMEN KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, BEZÜGLICH DIESES HANDBUCHS UND BELIEBIGER HIERIN ENTHALTENER INFORMATIONEN, INKLUSIVE ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF STILLSCHWEIGENDE GARANTIE HINSICHTLICH MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. KEYSIGHT ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FEHLER, DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTEN SIND, UND FÜR ZUFÄLLIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER LIEFERUNG, INGEBRAUCHNAHME ODER BENUTZUNG DIESER DOKUMENTATION. FALLS ZWISCHEN KEYSIGHT UND DEM BENUTZER EINE SEPARATE SCHRIFTLICHE VEREINBARUNG MIT GARANTIEBEDINGUNGEN BEZÜGLICH DES IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN MATERIALS BESTEHT, GELTEN DIE GARANTIEBEDINGUNGEN IN DER SEPARATEN VEREINBARUNG.

Sicherheitsinformationen

VORSICHT

















Ein Hinweis mit der Überschrift VORSICHT weist auf eine Gefahr hin. Er macht auf einen Betriebsablauf oder ein Verfahren aufmerksam, der bzw. das bei unsachgemäßer Durchführung zur Beschädigung des Produkts oder zum Verlust wichtiger Daten führen kann. Setzen Sie einen mit VORSICHT gekennzeichneten Vorgang erst dann fort, wenn Sie die angegebenen Hinweise vollständig verstanden haben und einhalten können.

WARNUNG

Eine WARNUNG weist auf eine Gefahr hin. Sie macht auf einen Betriebsablauf oder ein Verfahren aufmerksam, der bzw. das bei unsachgemäßer Durchführung zu Verletzungen oder zum Tod führen kann. Setzen Sie den Vorgang nach einem Hinweise mit der Überschrift WARNUNG nicht fort, wenn Sie die darin aufgeführten Hinweise nicht vollständig verstanden haben und einhalten können.

Sicherheitssymbole

Die folgenden Symbole auf dem Gerät und in der Dokumentation deuten auf Vorkehrungen hin, die ausgeführt werden müssen, um den sicheren Betrieb dieses Geräts zu gewährleisten.

	Gleichstrom (DC)		Aus (Netzteil)
	Wechselstrom (AC)		Ein (Netzteil)
	Sowohl Gleich- als auch Wechselstrom		Vorsicht, Stromschlagrisiko
	Drei-Phasen-Wechselstrom		Vorsicht, Stromschlagrisiko (spezifische Warn- und Vorsichtshinweise finden Sie im Handbuch).
	Anschluss an Schutzerde (Masse)		Vorsicht, heiße Oberfläche
	Schutzleiteranschluss		Aus-Stellung eines bistabilen Druckknopfes
	Rahmen- oder Gehäuseanschluss		Ein-Stellung eines bistabilen Druckknopfes
	Äquipotenzialität		Ausrüstung ständig durch Doppelisolierung oder verstärkte Isolierung geschützt

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Die folgenden allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen müssen während aller Phasen des Betriebs, des Services und der Reparatur dieses Instruments beachtet werden. Durch Missachtung dieser Sicherheitsvorkehrungen oder bestimmter Warnungen an einer anderen Stelle dieses Handbuchs werden die Sicherheitsstandards beim Entwurf, bei der Bereitstellung und bei der vorgesehenen Verwendung dieses Geräts verletzt. Keysight Technologies übernimmt bei Missachtung dieser Voraussetzungen durch den Kunden keine Haftung.

VORSICHT

- Trennen Sie die Stromverbindung und entladen Sie alle Hochspannungskondensatoren vor dem Testen.
 - Stellen Sie bei Messungen an schaltungsinternen Komponenten sicher, dass diese keine Spannung führen, bevor Sie die Testleitungen anschließen.
 - Dieses Messgerät wurde für die Verwendung in geschlossenen Räumen in einer Höhe bis zu 2.000 m entwickelt.
 - Verwenden Sie nur die angegebenen Batterietypen (Auflistung unter „Eigenschaften und Spezifikationen“ auf Seite 89). Das Messgerät wird über eine einzelne Standard-9-V-Batterie mit Strom versorgt. Stellen Sie sicher, dass die Batterie ordnungsgemäß in das LCR-Messgerät eingelegt ist und achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
 - Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, das Gerät über ein 12-V-Wechselstrom-zu-Gleichstrom-Netzteil mit der Stromversorgung zu verbinden. Wenn Sie mit dem Netzteil arbeiten, stellen Sie die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen der entsprechenden IEC-Norm sicher.
-

WARNUNG

- Verwenden Sie dieses Messgerät nur entsprechend der in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungsweise; anderenfalls können sich Beeinträchtigungen für den durch das Gerät gebotenen Schutz ergeben.
- Verwenden Sie das Messgerät nicht, wenn es beschädigt ist. Prüfen Sie vor Benutzung des Geräts das Gehäuse. Achten Sie auf Risse oder fehlende Kunststoffteile. Achten Sie besonders auf die Isolierung, welche die Anschlüsse umgibt.
- Prüfen Sie die Testleitungen auf beschädigte Isolierung und freiliegendes Metall. Prüfen Sie die Testleitungen auf Durchgang. Ersetzen Sie beschädigte Testleitungen vor der Verwendung des Messgeräts.
- Verwenden Sie das Messgerät nicht in der Nähe von explosiven Gasen, bei Vorhandensein von Dampf oder in feuchten Umgebungen.
- Verwenden Sie das Messgerät nie in Umgebungen mit feuchten Bedingungen oder, wenn Wasser auf der Oberfläche ist. Wenn das Messgerät feucht ist, stellen Sie sicher, dass das Gerät nur von dafür geschultem Personal getrocknet wird.
- Verwenden Sie für Arbeiten am Messgerät immer nur die angegebenen Ersatzteile.
- Wenn Sie die Sonden verwenden, behalten Sie die Finger immer hinter den Fingerschützern der Sonden.
- Wenn Sie die Sonden verbinden, verbinden Sie immer erst die allgemeine Messsonde, bevor Sie die stromführende Sonde verbinden. Wenn Sie die Sonden trennen, trennen Sie immer erst die stromführende Messsonde.
- Lösen Sie erst die Messsonden vom Messgerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung öffnen.
- Verwenden Sie das Messgerät nicht, wenn die Akkufachabdeckung oder ein Teil davon fehlt oder nicht fest sitzt.
- Laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie diesen, sobald die Anzeige des Akkustatus auf dem Bildschirm blinkt. Dadurch werden falsche Messungen vermieden, die möglicherweise zu einem Stromschlag oder zu einer Verletzung führen können.

Umgebungsbedingungen

Dieses Instrument ist für den Gebrauch in Räumen mit geringer Kondensation konstruiert. Die nachstehende Tabelle enthält die allgemeinen Anforderungen an die Umgebungsbedingungen für dieses Gerät.





Umgebungsbedingungen	Anforderungen
Betriebstemperatur	Volle Genauigkeit von -10 °C bis 55 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	Volle Genauigkeit bei bis zu 80% relativer Luftfeuchtigkeit
Lagerungstemperatur	-20 °C bis 70 °C
Lagerungsluftfeuchtigkeit	0% bis 80% nicht kondensierend
Höhe	Bis zu 2.000 m
Verschmutzungsgrad	Verschmutzungsgrad II

HINWEIS

Das U1731C/U1732C/U1733C Handheld- LCR-Messgerät entspricht den folgenden Sicherheits- und EMC-Anforderungen:

- IEC61010-1:2001/EN61010-1:2001 (zweite Ausgabe)
- IEC 61326-1:2005/EN 61326-1:2006
- Kanada: ICES/NMB-001:Ausgabe 4, Juni 2006
- Australien/Neuseeland: AS/NZS CISPR11:2004

Aufsichtsrechtliche Kennzeichnungen

	<p>Das CE-Zeichen ist eine registrierte Marke der Europäischen Gemeinschaft. Das CE-Zeichen gibt an, dass das Produkt allen relevanten europäischen rechtlichen Richtlinien entspricht.</p>		<p>Das RCM-Symbol ist eine registrierte Handelsmarke der Australian Communications and Media Authority.</p>
<p>ICES/NMB-001</p>	<p>ICES/NMB-001 gibt an, dass dieses ISM-Gerät der kanadischen Norm ICES-001 entspricht. Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB-001 du Canada.</p>		<p>Dieses Gerät entspricht der Kennzeichnungsanforderung gemäß WEEE-Richtlinie (2002/96/EC). Dieses angebrachte Produktetikett weist darauf hin, dass Sie dieses elektrische/elektronische Produkt nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.</p>
	<p>Dieses Zeichen gibt den Zeitraum an, in dem nicht erwartet wird, dass gefährliche oder giftige Substanzen bei sachgemäßer Benutzung aus dem Gerät entweichen oder verfallen. Die erwartete Nutzungsdauer dieses Produkts liegt bei vierzig Jahren.</p>		

Europäische Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 2002/96/EC

Dieses Gerät entspricht der Kennzeichnungsanforderung gemäß WEEE-Richtlinie (2002/96/EC). Dieses angebrachte Produktetikett weist darauf hin, dass Sie dieses elektrische/elektronische Produkt nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

Produktkategorie:

Im Bezug auf die Ausrüstungstypen in der WEEE-Richtlinie Zusatz 1, gilt dieses Instrument als „Überwachungs- und Kontrollinstrument“.

Das angebrachte Produktetikett ist unten abgebildet.



Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im Hausmüll.

Zur Entsorgung dieses Geräts wenden Sie sich an das nächste Keysight Service Center, oder rufen Sie <http://about.keysight.com/en/companyinfo/environment/takeback.shtml> , um weitere Informationen zu erhalten.

Vertrieb und technischer Support

Um zu Vertrieb und technischem Support Kontakt mit Keysight aufzunehmen, nutzen Sie die Support-Links auf den folgenden Websites von Keysight:

- <http://www.keysight.com/handheldlcr>
(produktspezifische Informationen und Support, Software- und Dokumentations-Updates)
- www.keysight.com/find/assist
(weltweite Kontaktinformationen für Reparatur und Service)

Inhalt

Sicherheitssymbole	3
Sicherheitshinweise	4
Umgebungsbedingungen	6
Aufsichtsrechtliche Kennzeichnungen	7
Europäische Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 2002/96/EC	8
Produktkategorie:	8
Vertrieb und technischer Support	8
1 Einleitung	
Über dieses Handbuch	18
Dokumentationen	18
Sicherheitshinweise	18
Vorbereiten des LCR-Messgeräts	19
Überprüfen Sie die Lieferung	19
Einlegen der Batterie	19
Einschalten des LCR-Messgeräts	21
Automatische Ausschaltfunktion (APO)	22
Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung	23
Auswählen des Bereichs	24
Anpassen des Neigungsständers	25
Anschließen des IR-USB-Kabels	26
Einschaltoptionen	27
Kurzbeschreibung des LCR-Messgeräts	28
Maße	28
Übersicht	30
Tastenfeld	32
Bildschirmanzeige	35
Eingangsanschlüsse	39
Reinigen des LCR-Messgeräts	40

2 Merkmale und Funktionen

Vornehmen von Messungen	42
Funktion für automatische Identifikation (Ai)	42
Messen der Induktivität (L)	45
Kapazitätsmessung (C)	47
Messen des Widerstands (R)	49
Messen der Impedanz (Z)	51
Messen von Ableitungsfaktor/Qualitätsfaktor/Phasenwinkel (D/Q/ θ)	53
Ändern der Testfrequenz	53
Auswählen des Parallel-/Serienschaltkreismodus (P/S)	53
Einstellen der Standardreferenztoleranz (Tol%)	54
Aktivieren von ESR-Messungen	55
Aktivieren von DCR-Messungen	55
Zusätzliche Funktionen	56
Sperrern der Anzeige (Hold)	56
Aktivieren des statischen Aufzeichnungsmodus (Rec)	56
Einstellen des Abgleichs für oberen/unteren Grenzwert (Grenze)	58
Durchführen relativer Messungen (Null)	61
Ausführen der Open/Short-CAL	62

3 Setup-Optionen

Verwenden des Menüs „Setup“	66
Bearbeiten von numerischen Werten	67
Zusammenfassung - Menü „Setup“	68
Setup-Menüelemente	70
Ändern des Verhaltens beim Einschalten	70
Ändern der Phasenwinkelbedingung der Ai-Funktion	77
Ändern der beim Einschalten aktiven Grenzwertkategorie und des Satzes	79
Ändern der benutzerdefinierten Werte für oberen/unteren Grenzwert	80
Ändern der Baudrate	82
Ändern der Paritätsprüfung	83
Ändern der Datenbits	84

Ändern der Warntonfrequenz	85
Sperren der Drucktasten	86
Ändern der autom. Ausschaltung und der Hintergrundlicht-Zeitschaltung	87
Zurücksetzen der Setup-Elemente	88

4 Eigenschaften und Spezifikationen

DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH LEER GELASSEN.

Liste der Abbildungen

Abbildung 1-1	Einlegen der Batterien	20
Abbildung 1-2	Einschalttaste	22
Abbildung 1-3	Anpassung des Neigungsständers und IR-Kabelverbindung	25
Abbildung 1-4	Keysight GUI Data Logger Software	26
Abbildung 1-5	Breitenmaße	28
Abbildung 1-6	Höhen- und Tiefenmaße	29
Abbildung 1-7	Vorderes Bedienfeld	30
Abbildung 1-8	Hinteres Bedienfeld	31
Abbildung 2-1	Verwenden der Ai-Funktion	42
Abbildung 2-2	Induktivitätsmessung mit Q-Faktor	45
Abbildung 2-3	Induktivitätsmessung	46
Abbildung 2-4	Kapazitätsmessung mit D-Faktor	47
Abbildung 2-5	Messen der Kapazität	48
Abbildung 2-6	Widerstandsmessung	49
Abbildung 2-7	Widerstandsmessung	50
Abbildung 2-8	Impedanzmessung mit Theta	51
Abbildung 2-9	Messen der Impedanz	52
Abbildung 2-10	Komponente überschreitet die eingestellte Toleranz	54
Abbildung 2-11	ESR-Messung mit Theta	55
Abbildung 2-12	DCR-Messung	55
Abbildung 2-13	Verwenden der Hold-Funktion	56
Abbildung 2-14	Verwenden der Rec-Funktion	57
Abbildung 2-15	Verwenden der Grenzwertfunktion	59
Abbildung 2-16	Obere und untere Grenzwerte	60
Abbildung 2-17	Anzeigen „nGo“ und „Go“	60
Abbildung 2-18	Verwenden der Nullfunktion	61
Abbildung 2-19	Verwenden der Cal-Funktion	63
Abbildung 2-20	Aufforderungen für offene Kalibrierung und Kurzschlusskalibrierung	63
Abbildung 3-1	Ändern des Messtyps beim Einschalten	71
Abbildung 3-2	Ändern der Testfrequenz beim Einschalten	72

Abbildung 3-3	Ändern der beim Einschalten aktiven Sekundärparameter und des Messmodus für Induktivitätsmessungen (L)	73
Abbildung 3-4	Ändern der beim Einschalten aktiven Sekundärparameter und des Messmodus für Kapazitätsmessungen (C)	74
Abbildung 3-5	Ändern der beim Einschalten aktiven Sekundärparameter und des Messmodus für Widerstandsmessungen (R)	75
Abbildung 3-6	Ändern der Open/Short-CAL beim Einschalten	76
Abbildung 3-7	Ändern der Phasenwinkelbedingung der Ai-Funktion	78
Abbildung 3-8	Ändern des beim Einschalten aktiven Grenzwert- und Kategoriesatzes	79
Abbildung 3-9	Ändern der benutzerdefinierten Werte für oberen/unteren Grenzwert	81
Abbildung 3-10	Ändern der Baudrate	82
Abbildung 3-11	Ändern der Paritätsprüfung	83
Abbildung 3-12	Ändern der Datenbits	84
Abbildung 3-13	Ändern der Warntonfrequenz	85
Abbildung 3-14	Sperrern der Drucktasten	86
Abbildung 3-15	Ändern der autom. Ausschaltung und der Hintergrundlicht-Zeitschaltung	87
Abbildung 3-16	Zurücksetzen der Setup-Elemente	88

Liste der Tabellen

Tabelle 1-1	Batteriestandsanzeige	21
Tabelle 1-2	Einschaltoptionen	27
Tabelle 1-3	Teile des vorderen Bedienfelds	30
Tabelle 1-4	Teile auf der Rückseite	31
Tabelle 1-5	Tastenfeldfunktionen	32
Tabelle 1-6	Allgemeine Meldeanzeigen	35
Tabelle 1-7	Maßeinheitenanzeige	38
Tabelle 1-8	Eingangsanschlüsse/Eingangsbuchsen	39
Tabelle 2-1	Automatische Identifizierung - Phasenwinkelregeln	43
Tabelle 2-2	Automatische Identifizierung - Serien/Parallel-Regeln für Widerstandsmessungen	43
Tabelle 2-3	Automatische Identifizierung - Serien/Parallel-Regeln für Kapazitätsmessungen	44
Tabelle 2-4	Automatische Identifizierung - Serien/Parallel-Regeln für Induktivitätsmessungen	44
Tabelle 2-5	Verfügbare Testfrequenzen	53
Tabelle 2-6	Werkseitig voreingestellte obere und untere Grenzwerte	58
Tabelle 3-1	Menü „Setup“ - Hauptfunktionen	66
Tabelle 3-2	Elementbeschreibungen für das Setup-Menü	68
Tabelle 3-3	Automatische Identifizierung - Phasenwinkelregeln	77
Tabelle 3-4	Benutzerdef. obere/untere Standardgrenzwerte	80

DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH LEER GELASSEN.

1 Einleitung

Über dieses Handbuch	18
Vorbereiten des LCR-Messgeräts	19
Kurzbeschreibung des LCR-Messgeräts	28
Reinigen des LCR-Messgeräts	40

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Ihr LCR-Messgerät bei der ersten Inbetriebnahme einrichten. Weiterhin werden alle Funktionen und Merkmale des LCR-Messgeräts beschrieben.

Über dieses Handbuch

Die Beschreibungen und Anweisungen in diesem Handbuch gelten für die Keysight U1731C, U1732C, und U1733C Handheld-LCR-Messgeräts (im Folgenden nur noch als das LCR-Messgerät bezeichnet).

In allen Abbildungen wird das Modell U1733C dargestellt.

Dokumentationen

Die folgenden Handbücher und Software sind für Ihr LCR-Messgerät verfügbar: Die aktuellen Versionen finden Sie auf unserer Webseite unter:

<http://www.keysight.com/find/hhTechLib>.

Prüfen Sie die Änderungsstandversion des jeweiligen Handbuchs auf der ersten Seite.

- **Benutzerhandbuch.** Dieses Handbuch.
- **Schnellstarthandbuch.** Gedruckte Kopie zur Verwendung im Freien, in der Lieferung enthalten.
- **Servicehandbuch.** Kostenfreier Download von der Keysight-Webseite.
- **Keysight GUI Data Logger-Software, Schnellstarthandbuch und Hilfe.** Kostenfreier Download von der Keysight-Webseite.

Sicherheitshinweise

In diesem Handbuch werden Sicherheitshinweise verwendet. (Formatbeispiele finden Sie im Abschnitt **Sicherheitsinformationen**). Machen Sie sich mit den Sicherheitshinweisen und deren Bedeutung vertraut, bevor Sie das LCR-Messgerät in Betrieb nehmen.

Weitere wichtige Sicherheitshinweise zur Verwendung dieses Produkts befinden sich im Abschnitt **Sicherheitshinweise**.

Setzen Sie den Vorgang nach einem Sicherheitshinweis nicht fort, wenn Sie die darin aufgeführten Hinweise nicht vollständig verstanden haben und nicht einhalten können.

Vorbereiten des LCR-Messgeräts

Überprüfen Sie die Lieferung

Wenn Sie das LCR-Messgerät erhalten, sollten Sie die Lieferung nach folgendem Verfahren überprüfen.

- 1** Überprüfen Sie die Transportverpackung auf Schäden. Zeichen einer Beschädigung können eine verbeulte oder zerrissene Transportverpackung oder eine unnormale Verdichtung oder Risse im Polstermaterial sein. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für den Fall auf, dass das LCR-Messgerät zurückgesandt werden muss.
- 2** Nehmen Sie den Inhalt vorsichtig aus der Transportverpackung und stellen Sie sicher, dass das Standardzubehör und Ihre bestellten Optionen in der Lieferung enthalten sind. Vergleichen Sie hierzu den Inhalt mit der Liste Mitgeliefertes Zubehör, die sich im *U1731C/U1732C/U1733C Schnellstarthandbuch* befindet.
- 3** Wenden Sie sich mit Fragen und Problemen an die Keysight-Kontakttelefonnummern auf der Rückseite dieses Handbuchs.

Einlegen der Batterie

Das LCR-Messgerät wird über eine einzelne 9-V-Alkalibatterie betrieben (im Lieferumfang enthalten). Bei Lieferung des LCR-Messgeräts ist die Alkalibatterie nicht im Gerät eingelegt.

Gehen Sie zum Einlegen der Batterie nach folgendem Verfahren vor.

VORSICHT

Bevor Sie die Batterie einlegen, müssen Sie alle Kabelverbindungen von den Anschlüssen trennen und sicherstellen, dass das LCR-Messgerät **AUSGESCHALTET** ist. Verwenden Sie nur Batterietypen, die im Abschnitt **„Eigenschaften und Spezifikationen“** auf Seite 89 angegeben sind.

- 1 Öffnen der Batterieabdeckung.** Heben Sie den Neigungsständer an. Lösen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und entfernen Sie anschließend die Batterieabdeckung wie in **Abbildung 1-1** gezeigt.
- 2 Einlegen der Batterien.** Achten Sie beim Einlegen auf die korrekte Batterienpolarität. Die Anschlussenden der Batterie sind im Batteriefach angezeigt.
- 3 Schließen der Batterieabdeckung.** Positionieren Sie die Batterieabdeckung wieder in der Ursprungsposition und befestigen Sie die Schraube.



Abbildung 1-1 Einlegen der Batterien

Die Batteriestandsanzeige in der unteren rechten Ecke der Anzeige zeigt den Batterieladestand an. In **Tabelle 1-1** sind die verschiedenen angezeigten Ladezustände beschrieben.

WARNUNG





Um falsche Anzeigewerte zu verhindern, welche zu elektrischen Schlägen oder Verletzungen führen könnten, wechseln Sie die Batterien aus, sobald die Anzeige für fast leere Batterien angezeigt wird. Entladen Sie die Batterie niemals durch Kurzschluss oder Polaritätsumkehrung.

VORSICHT

So vermeiden Sie Beschädigungen durch auslaufende Batterien:

- Entfernen Sie erschöpfte Batterien grundsätzlich sofort.
- Wenn das LCR-Messgerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien heraus und lagern Sie sie separat.

Tabelle 1-1 Batteriestandsanzeige

Anzeige	Ladezustand
	Voll geladen
	2/3 geladen
	1/3 geladen
 (periodisches Blinken)	Fast leere Batterien (weniger als ein Tag) ^[1]

[1] Batteriewechsel wird empfohlen. Verwenden Sie nur die auf [Seite 89](#) angegebenen Batterietypen.

Einschalten des LCR-Messgeräts

Drücken Sie die Einschalttaste einmal, um das LCR-Messgerät einzuschalten. Das LCR-Messgerät startet im Modus der automatischen Identifizierung (Ai) (Siehe [Seite 42](#)), wenn es das erste Mal eingeschaltet wird.



Abbildung 1-2 Einschalttaste

Drücken Sie die Einschalttaste erneut, um das LCR-Messgerät auszuschalten.

HINWEIS

Sie können das Einschaltverhalten des LCR-Messgeräts für zukünftige Einschaltvorgänge ändern. Weitere Informationen zur Einschalteneinstellung des LCR-Messgeräts finden Sie unter „**Ändern des Verhaltens beim Einschalten**“ auf Seite 70.

Automatische Ausschaltfunktion (APO)


Das LCR-Messgerät schaltet sich nach 5 Minuten (Standard) automatisch aus, wenn keine Taste gedrückt wird. Durch Drücken einer Taste wird das LCR-Messgerät nach der autom. Ausschaltung sofort wieder eingeschaltet.

Das Anzeigesymbol **APO** wird unten links in der Anzeige eingeblendet, wenn die APO-Funktion aktiviert ist.

HINWEIS

- Informationen über das Ändern der Zeit bis zur autom. Ausschaltung und zum Deaktivieren dieser Funktion finden Sie unter „**Ändern der autom. Ausschaltung und der Hintergrundlicht-Zeitschaltung**“ auf Seite 87.
- Wenn ein externer Stromanschluss verwendet wird, ist die APO-Funktion deaktiviert.

Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung


Wenn Sie in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen arbeiten, drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf , um die LCD-Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren.

Um Batterie zu sparen, gibt es eine Zeitabschaltung für die Hintergrundbeleuchtung, die benutzerdefiniert eingestellt werden kann. Standardmäßig schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach 30 Sekunden wieder aus.


HINWEIS

- Informationen über das Ändern der Zeit bis zur autom. Ausschaltung der Hintergrundbeleuchtung und zum Deaktivieren dieser Funktion finden Sie unter „Ändern der autom. Ausschaltung und der Hintergrundlicht-Zeitschaltung“ auf Seite 87.
 - Wenn ein externer Stromanschluss verwendet wird, ist die Hintergrundlicht-Funktion deaktiviert.
-


Auswählen des Bereichs

Durch Drücken auf  wechselt das LCR-Messgerät zwischen automatischer und manueller Bereichseinstellung. Wenn die manuelle Einstellung aktiviert ist, werden hiermit auch die verfügbaren Bereiche des LCR-Messgeräts angezeigt.

Die Automatische Bereichsauswahl ist praktisch, da das LCR-Messgerät automatisch einen geeigneten Bereich für das Lesen und Anzeigen einer jeden Messung auswählt. Bei der manuellen Bereichsauswahl werden jedoch bessere Leistungen erzielt, da das LCR-Messgerät den für jede Messung zu verwendeten Bereich nicht erst ermitteln muss.

Im autom. Bereichsauswahlmodus wählt das LCR-Messgerät den niedrigsten Bereich, um die höchstverfügbare Genauigkeit (Auflösung) für das Eingangssignal anzuzeigen. Wenn die manuelle Bereichsauswahl bereits ausgewählt ist, drücken Sie länger als 1 Sekunde auf , um in den autom. Bereichsauswahlmodus zu wechseln.

Wenn die autom. Bereichsauswahl aktiviert ist, drücken Sie auf , um in den manuellen Modus zu wechseln.

Bei jedem weiteren Drücken auf  wechselt das LCR-Messgerät zum nächsthöheren Bereich, außer der höchste Bereich wird bereits angezeigt, dann wechselt das Gerät in den niedrigsten Bereich.

Anpassen des Neigungsständers

Um das LCR-Messgerät in der Position von 60° aufzustellen, ziehen Sie den Neigungsständer maximal aus.

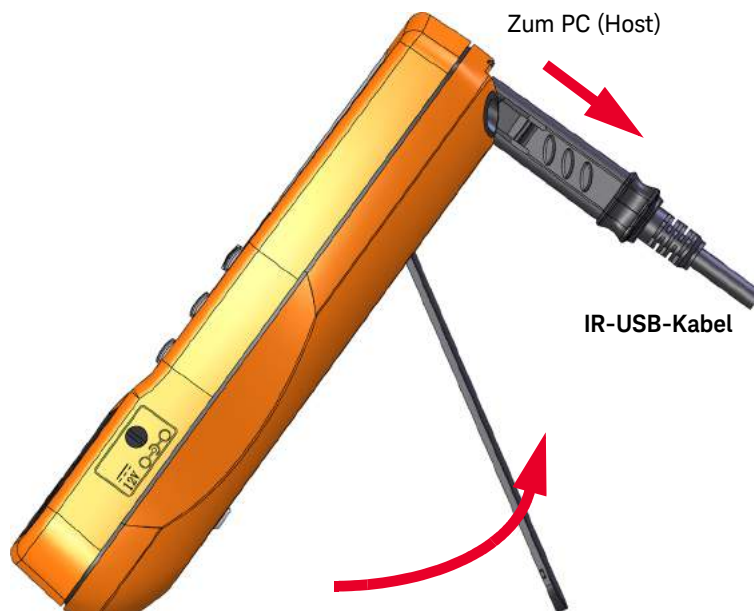


Abbildung 1-3 Anpassung des Neigungsständers und IR-Kabelverbindung

Anschließen des IR-USB-Kabels

Sie können mit der IR-Kommunikationsverbindung (IR-Kommunikationsanschluss auf der Rückseite) und der Keysight GUI Data Logger-Software das LCR-Messgerät fernsteuern. Deshalb können Sie Datenprotokollierungsoperationen in der Keysight GUI Data Logger-Anwendung nur durchführen, wenn das LCR-Messgerät mittels des USB-IR-Kabels an den PC angeschlossen ist.

Stellen Sie dabei sicher, dass das Keysight-Logo auf dem am LCR-Messgerät angeschlossenen U5481A IR-USB-Kabel (separat erhältlich) nach oben zeigt. Drücken Sie den IR-Stecker fest in den IR-Kommunikationsanschluss des LCR-Messgeräts bis er einrastet (Siehe [Abbildung 1-3](#))

Weitere Informationen über die IR-Kommunikationsverbindung und die Keysight GUI Data Logger-Software finden Sie in der *Hilfe der Keysight GUI Data Logger Software* und im *Schnellstarthandbuch*.

The screenshot shows the Keysight GUI Data Logger Software interface. On the left, there are control panels for Communication (Port, Baud Rate, Parity, Data Bits), Logging (Logging Mode, Logging Interval, Logging Start), and Configuration (Primary Measurement, Range, Secondary Measurement, Frequency). The main area is a table with the following columns: Time, Mode, Pkdg, L1, L2, Cp, Cs, R1, R2, Z, DCR, ESR, Q, DF, Thets. The table contains 15 rows of data, all recorded on 3/4/2011 at 1:50 PM. The data values vary across the columns, representing different electrical parameters over time.

Time	Mode	Pkdg	L1	L2	Cp	Cs	R1	R2	Z	DCR	ESR	Q	DF	Thets
3/4/2011 1:50:53 PM	Pa	100.0	-	-	-	-	-	107.0 G	-	-	-	95.78 u	99.00E+036	44.38
3/4/2011 1:50:54 PM	Pa	100.0	-	-	-	-	-	16.09 G	-	-	-	916.5 u	99.00E+036	43.78
3/4/2011 1:50:54 PM	Pa	100.0	-	-	-	-	-	8.799 G	-	-	-	916.5 u	99.00E+036	43.78
3/4/2011 1:50:54 PM	Pa	100.0	-	-	-	-	-	9.879 G	-	-	-	882.8 u	99.00E+036	2.967
3/4/2011 1:50:54 PM	Pa	100.0	-	-	-	-	-	19.94 G	-	-	-	395.3 u	99.00E+036	47.69
3/4/2011 1:50:56 PM	Pa	100.0	-	-	-	-	-	13.55 G	-	-	-	398.0 u	99.00E+036	21.39
3/4/2011 1:50:56 PM	Pa	100.0	-	-	-	-	-	29.34 G	-	-	-	229.7 u	99.00E+036	17.09
3/4/2011 1:50:57 PM	Pa	100.0	-	-	-	-	-	8.009 G	-	-	-	1.007 m	993.0	44.88
3/4/2011 1:50:57 PM	Pa	100.0	-	-	-	-	-	9.204 G	-	-	-	629.4 u	99.00E+036	10.48
3/4/2011 1:50:58 PM	Pa	100.0	-	-	-	-	-	19.90 G	-	-	-	629.4 u	99.00E+036	50.91
3/4/2011 1:50:58 PM	Pa	100.0	-	-	-	-	-	7.717 G	-	-	-	291.2 u	99.00E+036	14.87
3/4/2011 1:50:59 PM	Pa	100.0	-	-	-	-	-	6.840 G	-	-	-	372.3 u	99.00E+036	33.52
3/4/2011 1:50:59 PM	Pa	100.0	-	-	-	-	-	7.646 G	-	-	-	817.7 u	99.00E+036	31.90
3/4/2011 1:50:40 PM	Pa	100.0	-	-	-	-	-	8.618 G	-	-	-	216.6 u	99.00E+036	4.912
3/4/2011 1:50:41 PM	Pa	100.0	-	-	-	-	-	6.391 G	-	-	-	797.8 u	99.00E+036	16.96
3/4/2011 1:50:41 PM	Pa	100.0	-	-	-	-	-	11.91 G	-	-	-	918.1 u	99.00E+036	69.87
3/4/2011 1:50:42 PM	Pa	100.0	-	-	-	-	-	10.85 G	-	-	-	138.9 u	99.00E+036	17.03
3/4/2011 1:50:42 PM	Pa	100.0	-	-	-	-	-	33.92 G	-	-	-	10.78 u	99.00E+036	23.94
3/4/2011 1:50:43 PM	Pa	100.0	-	-	-	-	-	7.912 G	-	-	-	449.4 u	99.00E+036	13.86
3/4/2011 1:50:43 PM	Pa	100.0	-	-	-	-	-	27.26 G	-	-	-	131.4 u	99.00E+036	49.67
3/4/2011 1:50:44 PM	Pa	100.0	-	-	-	-	-	9.759 G	-	-	-	1.928 m	339.3	66.81

Abbildung 1-4 Keysight GUI Data Logger Software

Die Keysight GUI Data Logger Software und unterstützende Dokumente (*Hilfe* und *Schnellstarthandbuch*) sind als Download kostenlos verfügbar unter <http://www.keysight.com/find/hhTechLib>.







Das U5481A IR-USB-Kabel können Sie bei einem Keysight-Fachhändler in Ihrer Nähe erwerben.

Einschaltoptionen

Einige Optionen können nur ausgewählt werden, während Sie das LCR-Messgerät einschalten. Diese Einschaltoptionen sind in untenstehender Liste angegeben.

Zum Auswählen einer Einschaltoption drücken Sie die in **Tabelle 1-2** angegebene Taste und halten Sie diese gedrückt, während Sie das LCR-Messgerät einschalten (⏻).

Tabelle 1-2 Einschaltoptionen

Taste	Beschreibung
	Prüft die LCD-Anzeige. Alle Anzeigesymbole werden auf dem LCD angezeigt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um diesen Modus zu verlassen.
	Simulieren des APO-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das LCR-Messgerät erneut einzuschalten und den Normalbetrieb wieder aufzunehmen.
	Prüft die Firmware-Version. Die Firmware-Version des LCR-Messgeräts wird in der Primäranzeige angezeigt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um diesen Modus zu verlassen.
	Führt die Open/Short-CAL auf allen Frequenzen und allen Bereichen für den Benutzermodus (OS-User) aus. ^[1]
	Aktiviert das Einrichtungsmenü. In Kapitel 3 , „Setup-Optionen“, ab Seite 65 erhalten Sie weitere Informationen. Drücken und halten Sie  länger als 1 Sekunde, um diesen Modus zu beenden.

[1] Die Open/Short-CAL benötigt etwa 1,5 Minuten, bis sie abgeschlossen ist.

Kurzbeschreibung des LCR-Messgeräts

Maße

Vorderansicht



Abbildung 1-5 Breitenmaße

Rück- und Seitenansicht

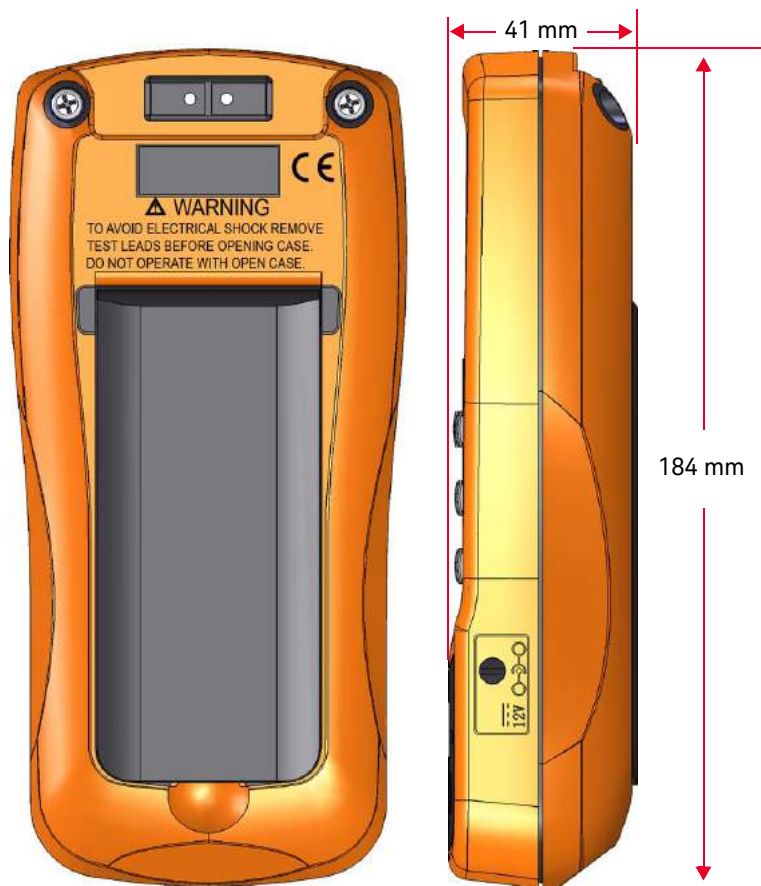


Abbildung 1-6 Höhen- und Tiefenmaße

Übersicht

Vorderes Bedienfeld

In diesem Abschnitt werden die vorderen Bedienfeldteile des LCR-Messgeräts beschrieben. Klicken Sie auf die entsprechenden Seiten „Weitere Informationen“ in [Tabelle 1-3](#), um mehr Informationen zu jedem Teil zu erhalten.



Abbildung 1-7 Vorderes Bedienfeld

Tabelle 1-3 Teile des vorderen Bedienfelds

Legende	Beschreibung	Weitere Informationen zu:
1	Bildschirmanzeige	Seite 35
2	Tastenfeld	Seite 32
3	Eingangsanschlüsse und Eingangsbuchsen	Seite 39

Hinteres Bedienfeld

In diesem Abschnitt werden die Teile auf der Rückseite des Bedienfelds des LCR-Messgeräts beschrieben. Klicken Sie auf die entsprechenden Seiten „Weitere Informationen“ in [Tabelle 1-4](#), um mehr Informationen zu jedem Teil zu erhalten.

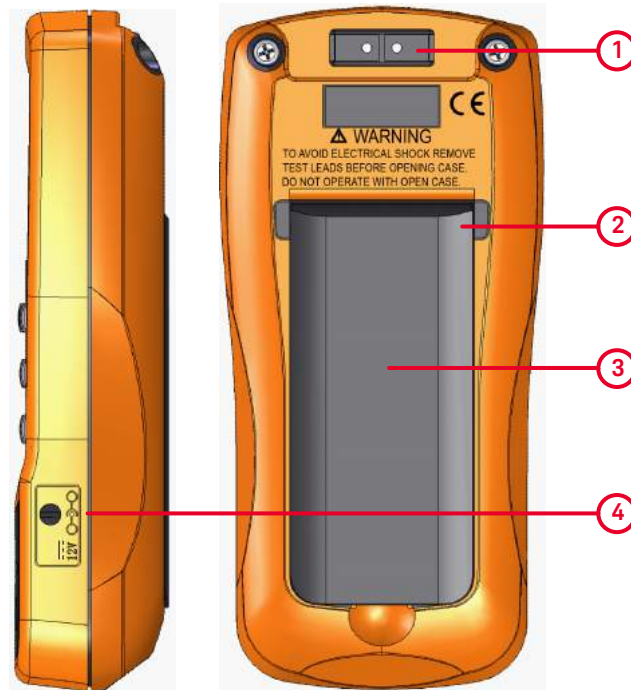


Abbildung 1-8 Hinteres Bedienfeld

Tabelle 1-4 Teile auf der Rückseite

Legende	Beschreibung	Weitere Informationen zu:
1	IR-Kommunikationsanschluss	Seite 26
2	Neigungsständer	Seite 25
3	Batterieabdeckung (Für den Zugriff Neigungsständer anheben)	Seite 19
4	Eingang für das externe Netzteil ^[1]	-

[1] Für den Anschluss für das externe Netzteil benötigen Sie eine Eingangsspannung von +12 V Gleichstrom.

Tastefeld

Die Funktion jeder Taste ist nachstehend dargestellt. Durch Drücken einer Taste wird eine Funktion aktiviert, das entsprechende Symbol angezeigt und ein Ton ausgegeben.

Die Tastenfunktionen des Tastenfelds des U1731C/U1732C/U1733C (Siehe [Abbildung 1-7](#)) wird in [Tabelle 1-5](#) beschrieben. Klicken Sie auf die entsprechenden Seiten „Weitere Informationen“ in [Tabelle 1-5](#), um weitere Informationen zu jeder Funktion zu erhalten.

Tabelle 1-5 Tastenfeldfunktionen











Legende	Aktive Funktion, wenn die Taste:		Weitere Informationen zu:
	weniger als 1 Sekunde gedrückt wird	mehr als 1 Sekunde gedrückt wird	
	Schaltet das LCR-Messgerät ein bzw. aus.	-	Seite 21
 ESR	Startet oder beendet den Modus für die automatische Identifizierung. - Drücken Sie erneut auf  , während das Symbol  angezeigt wird, um den Modus zu beenden.	Aktiviert oder deaktiviert den ESR-Modus (Equivalent Series Resistance – äquivalenter Serienwiderstand). - Drücken Sie länger als 1 Sekunde auf  , um diesen Modus zu beenden. Das LCR-Messgerät kehrt standardmäßig zur Kapazitätsmessung zurück.	Seite 42
 Save	Hält den aktuellen Messwert auf der Anzeige oder gibt ihn frei. - Drücken Sie erneut auf  , um den Messwert zu aktualisieren, sobald dieser stabil ist. - Drücken Sie länger als 1 Sekunde auf  , um diesen Modus zu beenden.	Startet oder beendet den statischen Aufzeichnungsmodus. - Drücken Sie erneut auf  , um zwischen den Messwerten für Maximum (Max), Minimum (Min), Durchschnitt (Avg) und den aktuellen (MaxMinAvg) Messwerten umzuschalten. - Drücken Sie länger als 1 Sekunde auf  , um diesen Modus zu beenden.	Seite 56

Tabelle 1-5 Tastenfeldfunktionen (Fortsetzung)




















Legende	Aktive Funktion, wenn die Taste:		Weitere Informationen zu:
	weniger als 1 Sekunde gedrückt wird	mehr als 1 Sekunde gedrückt wird	
 <p>Wechseln zwischen Ableitungsfaktormessung (D), Qualitätsfaktormessung (Q) und Phasenwinkelmessung (θ)</p>		<p>Aktiviert oder deaktiviert den Grenzwertabgleichmodus.</p> <ul style="list-style-type: none"> Während das Symbol Limit blinkt: <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie erneut auf  und , um zwischen oberen (H) und unteren (L) Grenzwerten umzuschalten. Verwenden Sie die Tasten  und , um einen Satz für oberen/unteren Grenzwert (1 bis 16) zu wählen. Drücken Sie auf , um die Grenzwertklassifizierung (mit der ausgewählten Grenzwerteinstellung) zu starten, oder wenn nach 3 Sekunden keine Aktivität gemessen wird, beginnt der Grenzwertabgleich. Drücken Sie länger als 1 Sekunde auf , um diesen Modus zu beenden. 	<p>Seite 53 und Seite 58</p>
 <p>Auswählen der Testfrequenz</p> <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie erneut auf , um sich durch die verschiedenen Testfrequenzen (100Hz bis 100 kHz) zu bewegen. 		<p>Nur U1733C: Aktiviert oder deaktiviert den DCR-Modus (Direct Current Resistance – Gleichstromwiderstand)</p> <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie länger als 1 Sekunde auf , um diesen Modus zu beenden. Das LCR-Messgerät kehrt standardmäßig zur Induktivitätsmessung zurück. 	<p>Seite 53</p>
 <p>Deaktiviert die automatische Bereichsauswahl und legt eine manuelle Bereichsauswahl fest.</p> <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie erneut auf , um durch die verfügbaren Messbereiche zu navigieren. 		<p>Ermöglicht eine automatische Bereichswahl.</p>	<p>Seite 24</p>

Tabelle 1-5 Tastenfeldfunktionen (Fortsetzung)

Legende	Aktive Funktion, wenn die Taste:		Weitere Informationen zu:
	weniger als 1 Sekunde gedrückt wird	mehr als 1 Sekunde gedrückt wird	
	Wechseln zwischen Impedanzmessung (Z), Induktivitätsmessung (L), Kapazitätsmessung (C) und Widerstandsmessung (R)	Umschalten zwischen Parallel- und Serienschaltungsmodus	Seite 43 bis Seite 51 und Seite 53
	<p>Stellt den Toleranzmodus ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie eine geeignete Komponente am Eingangsanschluss an und drücken Sie auf , um den Wert, der auf der Sekundäranzeige angezeigt wird, als Standardreferenzwert einzustellen. Drücken Sie erneut auf , um sich durch die verschiedenen Toleranzwerte (1% bis 20%) zu bewegen. 	<p>Schaltet das LCD-Hintergrundlicht für 15 Sekunden (Standard) ein, bzw. das Hintergrundlicht wird ausgeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Informationen zur benutzerdefinierten Zeitabschaltung der Hintergrundbeleuchtung finden Sie unter „Ändern der autom. Ausschaltung und der Hintergrundlicht-Zeitschaltung“ auf Seite 87. 	Seite 54 und Seite 23
	<p>Stellt den Nullmodus/relativen Modus ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> Der angezeigte Wert wird als Referenz gespeichert, die von nachfolgenden Messungen abgezogen werden soll. Drücken Sie erneut auf , den Nullmodus zu beenden. 	<p>Aktiviert den Open/Short-Kalibrierungsmodus für den ausgewählten Bereich und die ausgewählte Testfrequenz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Befolgen Sie die Anweisungen in der Anzeige (Open- oder Short-Anschluss) und drücken Sie auf , um den Kalibrierungsprozess zu starten. Das LCR-Messgerät kehrt zur normalen Anzeige zurück, sobald die Kalibrierung abgeschlossen ist. 	Seite 61 und Seite 62

Bildschirmanzeige

In diesem Abschnitt werden die Funktionen beschrieben, denen die Meldeanzeigen des LCR-Messgeräts zugewiesen sind. Unter „Maßeinheiten“ auf Seite 38 finden Sie eine Liste der verfügbaren Messungssignale und Kennzeichnungen.

Allgemeine Meldeanzeigen

Die allgemeinen Meldeanzeigen des LCR-Messgeräts werden in untenstehender Tabelle beschrieben.

Jede Meldeanzeige der Bildschirmanzeige des U1731C/U1732C/U1733C (siehe [Abbildung 1-7](#)) wird in [Tabelle 1-6](#) beschrieben. Klicken Sie auf die entsprechenden Seiten „Weitere Informationen“ in [Tabelle 1-6](#), um mehr Informationen zu jeder Meldeanzeige zu erhalten.

Tabelle 1-6 Allgemeine Meldeanzeigen





Legende	Beschreibung	Weitere Informationen zu:
	Fernbedienung über PC	Seite 26
ESR	ESR (Equivalent Series Resistance – äquivalenter Serienwiderstand).	
DCR	Widerstandsmessung durch Gleichstrom	
OS-Factory	LCR-Messgerät verwendet werksseitig festgelegte Einstellungen für Open/Short-CAL	Seite 62
OS-User	LCR-Messgerät verwendet vom Benutzer festgelegte Einstellungen für Open/Short-CAL	
100Hz	Messfrequenz des Prüfsignals ist 100 Hz.	
120Hz	Messfrequenz des Prüfsignals ist 120 Hz.	
1kHz	Messfrequenz des Prüfsignals ist 1 kHz.	Seite 53
10kHz	Messfrequenz des Prüfsignals ist 10 kHz.	
100kHz	Messfrequenz des Prüfsignals ist 100 kHz.	

Tabelle 1-6 Allgemeine Meldeanzeigen (Fortsetzung)

Legende	Beschreibung	Weitere Informationen zu:
Tol	Toleranzmodusanzeige für die Klassifizierung L, C oder R	
1%	Toleranz für das Klassifizieren der Kapazität ist auf 1% eingestellt.	
5%	Toleranz für das Klassifizieren der Kapazität ist auf 5% eingestellt.	Seite 54
10%	Toleranz für das Klassifizieren der Kapazität ist auf 10% eingestellt.	
20%	Toleranz für das Klassifizieren der Kapazität ist auf 20% eingestellt.	
Hold	Datenhaltemodus	Seite 56
•)	Akustisches Signal für Toleranz- und Grenzmodus	Seite 85
D	Anzeige des Ableitungsfaktors	
Q	Anzeige des Qualitätsfaktors	Seite 53
θ	Nullphasenwinkel der Impedanz	
-000	Sekundäranzeige	-
° % kHz	Maßeinheiten für die Sekundäranzeige	Seite 38
Z	Impedanzmessung	Seite 51
L	Induktivitätsmessung	Seite 45
C	Kapazitätsmessung	Seite 47
R	Widerstandsmessung	Seite 49
MaxMinAvg	Aktueller Messwert wird auf Primäranzeige angezeigt	
Max	Höchster Messwert wird auf Primäranzeige angezeigt	Seite 56
Min	Niedrigster Messwert wird auf Primäranzeige angezeigt	
Avg	Durchschnittsmesswert wird auf Primäranzeige angezeigt	
Δ	Anzeige für relativ Null	Seite 61

Tabelle 1-6 Allgemeine Meldeanzeigen (Fortsetzung)

Legende	Beschreibung	Weitere Informationen zu:
Auto	Autom. Bereichsauswahl	Seite 24
Limit	Grenzmodus	
▲	Ausgeben des HI-Grenzwerts	Seite 58
▼	Ausgeben des LO-Grenzwerts	
APO	Anzeige der automatischen Abschaltfunktion	Seite 22
-18888	Primäranzeige	-
PrFH MkΩs	Maßeinheiten für die Primäranzeige	Seite 38
P 	Anzeige für Parallelmodus	Seite 53
S 	Anzeige für Serienmodus	
	Akkukapazitätsanzeige	Seite 21

Maßeinheiten

Die für jede Messfunktion im LCR-Messgerät verfügbaren Symbole und Kennzeichnungen werden in [Tabelle 1-7](#) beschrieben. Die unten aufgelisteten Einheiten sind für die Primäranzeigenmessungen des LCR-Messgeräts gültig.

Tabelle 1-7 Maßeinheitenanzeige

Symbol/ Kennzeichnung	Beschreibung	
M	Mega	1E+06 (1000000)
k	Kilo	1E+03 (1000)
m	Milli	1E-03 (0,001)
μ	Micro	1E-06 (0,000001)
n	Nano	1E-09 (0,000000001)
p	pico	1E-12 (0.000000000001)
°	Grad, Maßeinheit für die Phasenwinkelmessung	
%	Prozentsatz, Maßeinheit für die Toleranzmessung	
μH, mH, H	Henry, Maßeinheiten für die Induktivitätsmessung	
pF, nF, μF, mF	Farad, Maßeinheiten für die Kapazitätsmessung	
Ω, kΩ, MΩ	Ohm, Maßeinheiten für Widerstands- und Impedanzmessungen	
kHz, Hz	Hertz, Maßeinheiten für Frequenzmessungen	




Eingangsanschlüsse

In der folgenden Tabelle werden die Anschlüsse des LCR-Messgeräts beschrieben.

WARNUNG

Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, überschreiten Sie nicht die Eingangsbeschränkung. Wenden Sie an den Eingangsanschlüssen keine Spannung an. Entladen Sie den Kondensator vor der Testdurchführung.

Tabelle 1-8 Eingangsanschlüsse/Eingangsbuchsen

Eingangsanschluss/ Buchse	Beschreibung
	Positive Anschluss-/Komponentenbuchse
	Negative Anschluss-/Komponentenbuchse
	Schutzanschluss-/Komponentenbuchse

Reinigen des LCR-Messgeräts

WARNUNG

Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das LCR-Messgerät eindringt, um Stromschlägen und Schäden am Gerät zu vermeiden.

Schmutz oder Feuchtigkeit in den Anschlüssen kann die Messwerte verzerren. Führen Sie zum Reinigen des LCR-Messgeräts folgende Schritte aus.

- 1** Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie die Messleitungen ab.
- 2** Drehen Sie das Gerät um und schütteln Sie jeglichen Schmutz heraus, der sich in den Anschlüssen angesammelt hat.
- 3** Wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab – verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.
- 4** Reinigen Sie die Kontakte jedes Anschlusses mit einem sauberen, alkoholgetränkten Wattetupfer.


2 Merkmale und Funktionen

Vornehmen von Messungen	42
Zusätzliche Funktionen	56

Dieses Kapitel enthält detaillierte Informationen zu den Merkmalen und Funktionen dieses LCR-Messgeräts.

Vornehmen von Messungen

Funktion für automatische Identifikation (Ai)

Drücken Sie auf , um automatisch die geeignete Messung für das Messobjekt (device-under-test - DUT) zu identifizieren.

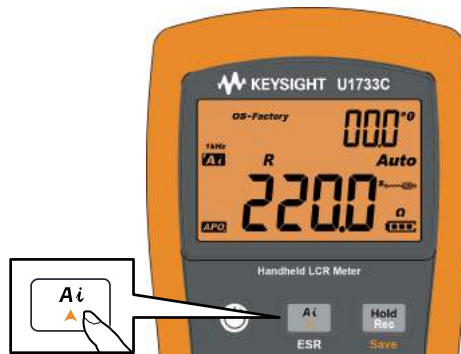


Abbildung 2-1 Verwenden der Ai-Funktion

Die Meldeanzeige  blinkt, während das LCR-Messgerät das Messobjekt identifiziert und

- eine geeignete Messung in der Primäranzeige (L, C oder R) und Sekundäranzeige (D, Q, oder θ) auswählt,
- einen passenden Bereich auswählt, und
- einen geeigneten Messmodus (Serien oder parallel) auswählt.

HINWEIS

Die Funktion Ai hilft dabei, L-, C- oder R-Messungen automatisch entsprechend dem im Messobjekt ermittelten Impedanzwinkel auszuwählen. Informationen zu Phasenwinkelregeln finden Sie in [Tabelle 2-1](#).

Die standardmäßige Phasenwinkelbedingung ist auf 10° eingestellt. Sie können diesen Winkel im Setup-Menü von 5° bis 45° ändern. In „[Ändern der Phasenwinkelbedingung der Ai-Funktion](#)“ auf Seite 77 erhalten Sie weitere Informationen.

Der Messmodus (Serien oder parallel) wird automatisch aus der Richtung der automatischen Bereichsauswahl identifiziert.

Tabelle 2-2, **Tabelle 2-3** und **Tabelle 2-4** listen die verwendeten Regeln für Serien/parallel auf.

Tabelle 2-1 Automatische Identifizierung - Phasenwinkelregeln

Phasenwinkel ^[1]	Primäranzeige	Sekundäranzeige
$-\text{Set} < \theta < +\text{Set}$	R	θ
$\theta \geq +\text{Set}$	L	Q
$\theta \leq -\text{Set}$	C	D

[1] Wobei $\pm\text{Set}$ der ausgewählte Phasenwinkel ist.

Tabelle 2-2 Automatische Identifizierung - Serien/Parallel-Regeln für Widerstandsmessungen

Widerstandsbereich	Niedriger Bereich	Hoher Bereich
200 M Ω	Parallel	Parallel
20 M Ω	Parallel	Parallel
2000 k Ω	Parallel	Parallel
200 k Ω	Parallel	Parallel
20 k Ω	Parallel	Serie
2000 Ω	Parallel	Serie
200 Ω	Parallel	Serie
20 Ω	Serie	Serie
2 Ω	Serie	Serie

Tabelle 2-3 Automatische Identifizierung - Serien/Parallel-Regeln für Kapazitätsmessungen

Bereich	100 Hz		120 Hz		1 kHz		10 kHz		100 kHz	
	Unten	Oben	Unten	Oben	Unten	Oben	Unten	Oben	Unten	Oben
20 mF	Serie	Serie	Serie	Serie	-	-	-	-	-	-
2000 µF	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	-	-	-	-
200 µF	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	-	-
20 µF	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
2000 nF	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Serie	Serie	Serie
200 nF	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Serie
20 nF	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel
2000 pF	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel
200 pF	-	-	-	-	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Serie	Parallel
20 pF	-	-	-	-	-	-	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel

Tabelle 2-4 Automatische Identifizierung - Serien/Parallel-Regeln für Induktivitätsmessungen





Bereich	100 Hz		120 Hz		1 kHz		10 kHz		100 kHz	
	Unten	Oben	Unten	Oben	Unten	Oben	Unten	Oben	Unten	Oben
2000 H	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	-	-	-	-
200 H	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	-	-
20 H	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel
2000 mH	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel
200 mH	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Parallel
20 mH	Serie	Serie	Serie	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie
2000 µH	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie
200 µH	-	-	-	-	Serie	Serie	Serie	Serie	Parallel	Serie
20 µH	-	-	-	-	-	-	Serie	Serie	Serie	Serie

Messen der Induktivität (L)

Stellen Sie das LCR-Messgerät zur Induktivitätsmessung wie in [Abbildung 2-3](#) ein.

HINWEIS

Es wird empfohlen, die Open/Short-Kalibrierung (siehe [Seite 62](#)) auszuführen, bevor Sie das LCR-Messgerät testen, um die optimale Präzision für alle Induktivitäts-, Kapazitäts- und Widerstandsmessungen für die niedrigsten oder höchsten Bereiche zu erhalten.

- 1 Drücken Sie auf , um das LCR-Messgerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie auf , um eine geeignete Testfrequenz auszuwählen und
 - a drücken Sie auf , um die automatische Identifizierungsfunktion zu aktivieren oder
 - b drücken Sie auf , um die Induktivitätsmessung auszuwählen.

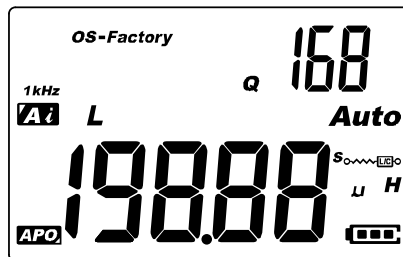



Abbildung 2-2 Induktivitätsmessung mit Q-Faktor

- 3 Setzen Sie einen Induktor in eine der Komponenteneingangsbuchsen ein oder verbinden Sie die Testklemme Ihrem Bedarf entsprechend mit den Komponentenkabeln.
- 4 Drücken Sie auf , um die Sekundäranzeigenmessung zu ändern (D, Q, oder θ).
- 5 Lesen Sie die Anzeigenwerte ab.

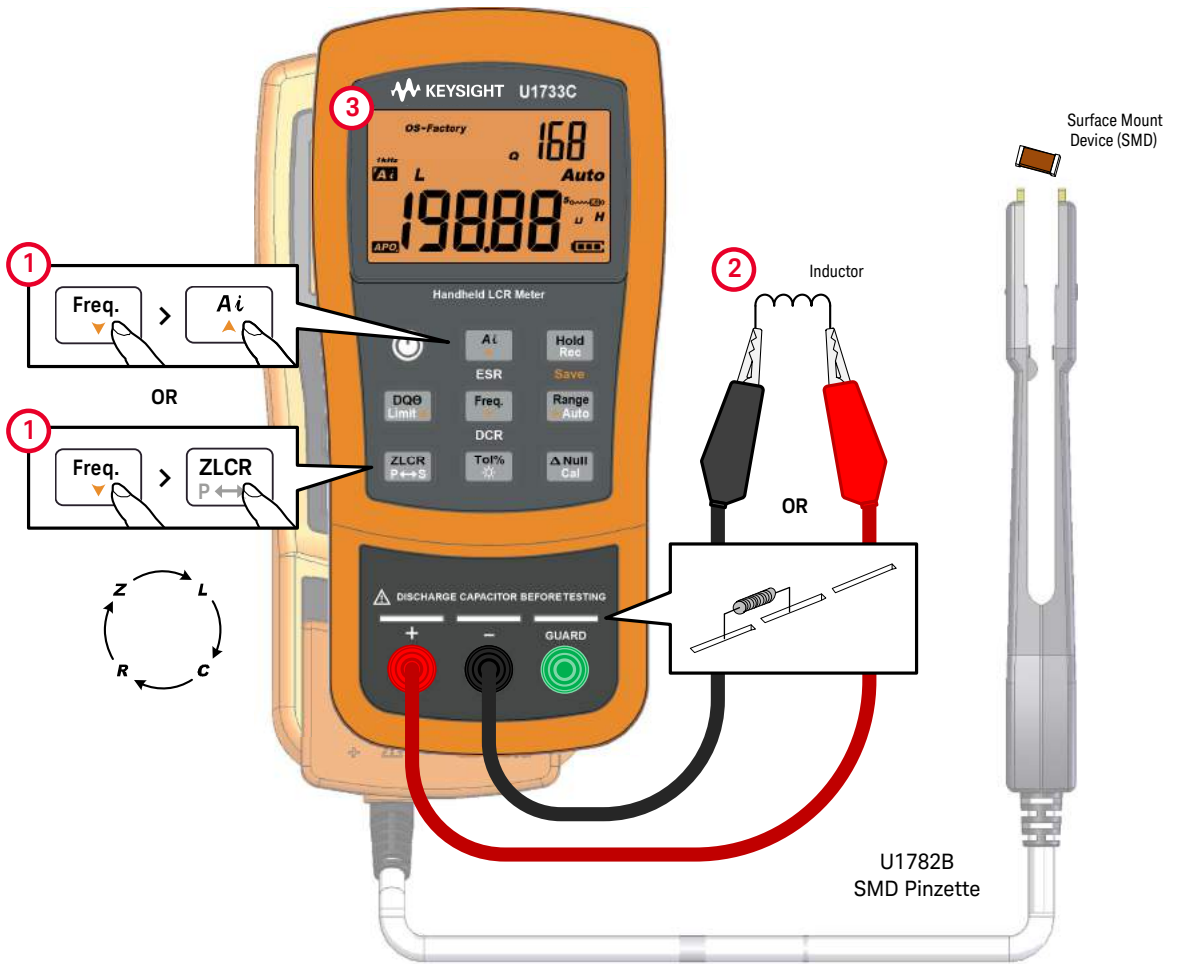






Abbildung 2-3 Induktivitätsmessung

Kapazitätsmessung (C)

Stellen Sie das LCR-Messgerät zur Kapazitätsmessung wie in [Abbildung 2-5](#) ein.

WARNUNG

Um in Verbindung mit Elektrizität entstehenden Verletzungen oder Beschädigungen vorzubeugen, sollte der zu testende Kondensator vor der Messung entladen werden.

- 1 Drücken Sie auf , um das LCR-Messgerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie auf , um eine geeignete Testfrequenz auszuwählen und
 - a drücken Sie auf , um die automatische Identifizierungsfunktion zu aktivieren oder
 - b drücken Sie auf , um die Kapazitätsmessung auszuwählen.

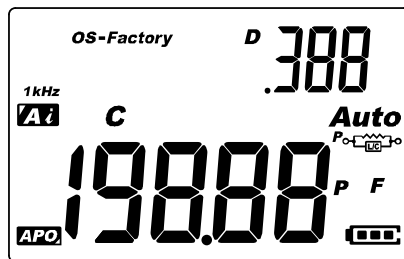



Abbildung 2-4 Kapazitätsmessung mit D-Faktor

- 3 Setzen Sie einen Kondensator in eine der Komponenteneingangsbuchsen ein oder verbinden Sie die Testklemme Ihrem Bedarf entsprechend mit den Komponentenkabeln.
- 4 Drücken Sie auf , um die Sekundäranzeigenmessung zu ändern (D, Q, oder θ).
- 5 Lesen Sie die Anzeigenwerte ab.

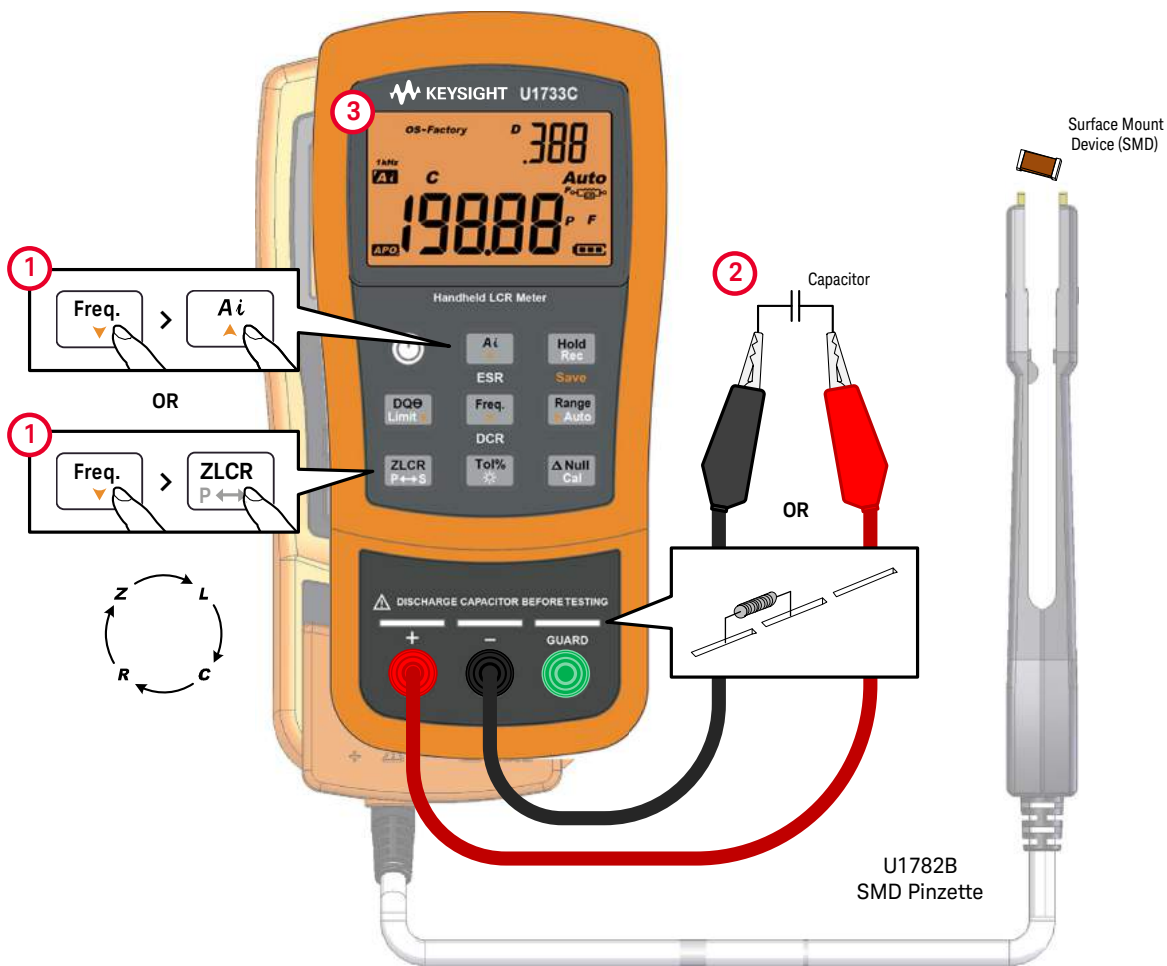






Abbildung 2-5 Messen der Kapazität

Messen des Widerstands (R)

Stellen Sie das LCR-Messgerät zur Widerstandsmessung wie in [Abbildung 2-7](#) ein.

VORSICHT

Um eventuelle Schäden am LCR-Messgerät oder am zu testenden Gerät zu vermeiden, unterbrechen Sie den Schaltkreisstrom und entladen Sie alle Kondensatoren, bevor Sie den Widerstand messen.

- 1 Drücken Sie auf , um das LCR-Messgerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie auf , um eine geeignete Testfrequenz auszuwählen und
 - a drücken Sie auf , um die automatische Identifizierungsfunktion zu aktivieren oder
 - b drücken Sie auf , um die Widerstandsmessung auszuwählen.

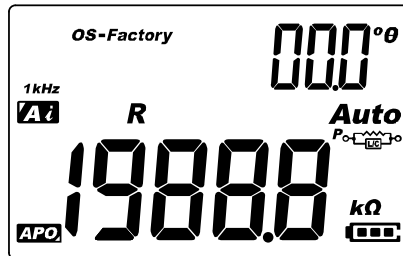


Abbildung 2-6 Widerstandsmessung

- 3 Setzen Sie einen Widerstand in eine der Komponenteneingangsbuchsen ein oder verbinden Sie die Testklemme Ihrem Bedarf entsprechend mit den Komponentenkabeln.
- 4 Lesen Sie die Anzeige.

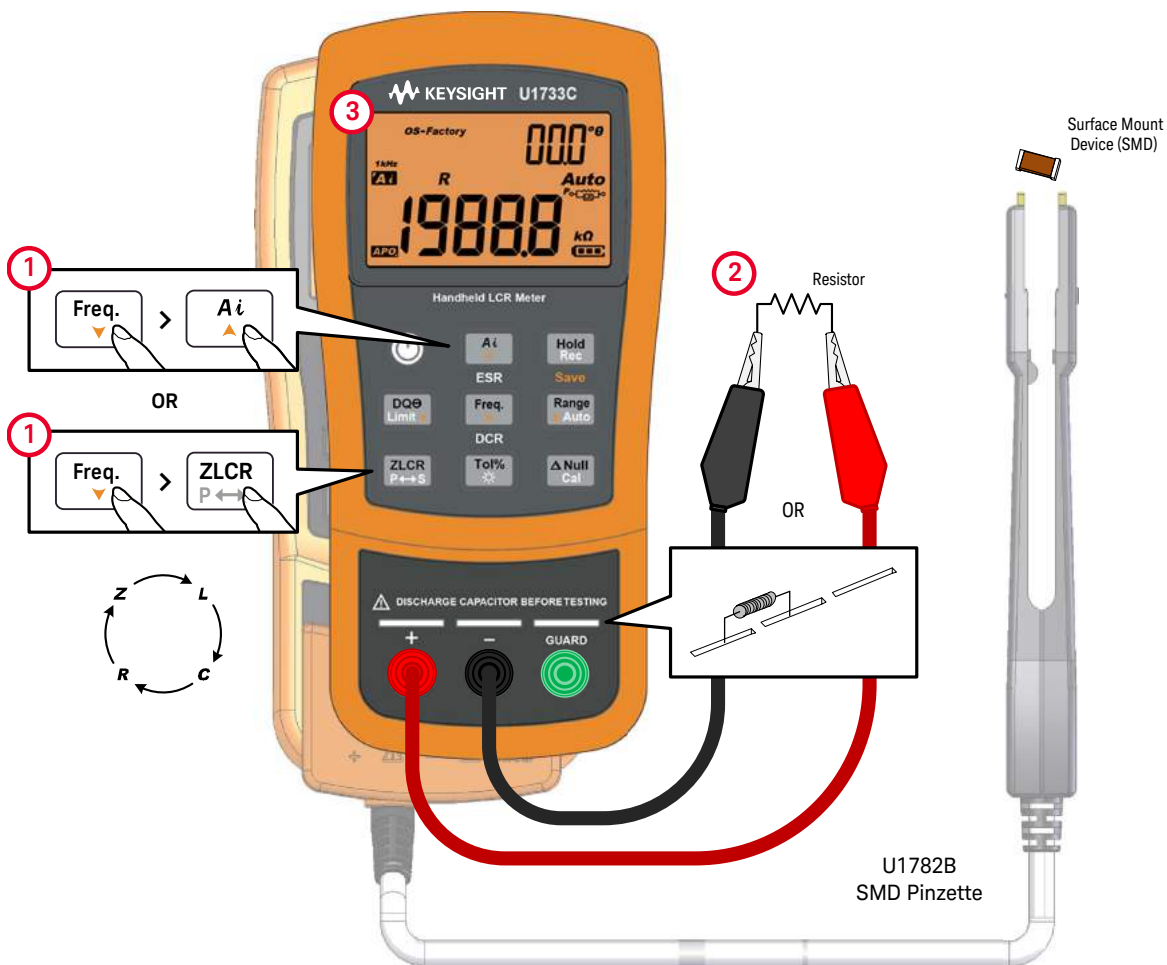


Abbildung 2-7 Widerstandsmessung




Messen der Impedanz (Z)

Alle Schaltkreiskomponenten, Widerstände, Kondensatoren und Induktoren besitzen Störkomponenten. Dies sind beispielsweise unerwünschter Widerstand in Kondensatoren, unerwünschte Kapazität in Induktoren und unerwünschte Induktivität in Widerständen. Daher sollten einfache Komponenten als komplexe Impedanzen konstruiert werden.

Stellen Sie das LCR-Messgerät zur Impedanzmessung wie in [Abbildung 2-9](#) ein.

HINWEIS

Weitere Informationen zu Impedanzmessungstheorien finden Sie im *Impedance Measurement Handbook*. Dieses Dokument kann von unserer Webseite unter <http://www.keysight.com/find/lcrmeters> heruntergeladen werden.

- 1 Drücken Sie auf , um das LCR-Messgerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie auf , um eine geeignete Testfrequenz auszuwählen und anschließend auf , um die Impedanzmessung auszuwählen.

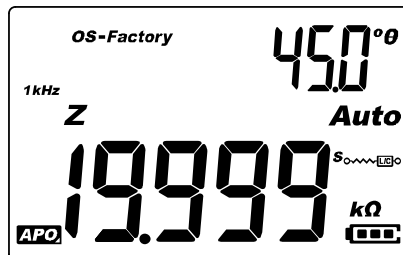



Abbildung 2-8 Impedanzmessung mit Theta

- 3 Setzen Sie eine Komponente in eine der Komponenteneingangsbuchsen ein oder verbinden Sie die Testklemme Ihrem Bedarf entsprechend mit den Komponentenkabeln.
- 4 Drücken Sie auf , um die Sekundäranzeigenmessung zu ändern (D, Q, oder θ).
- 5 Lesen Sie die Anzeigenwerte ab.

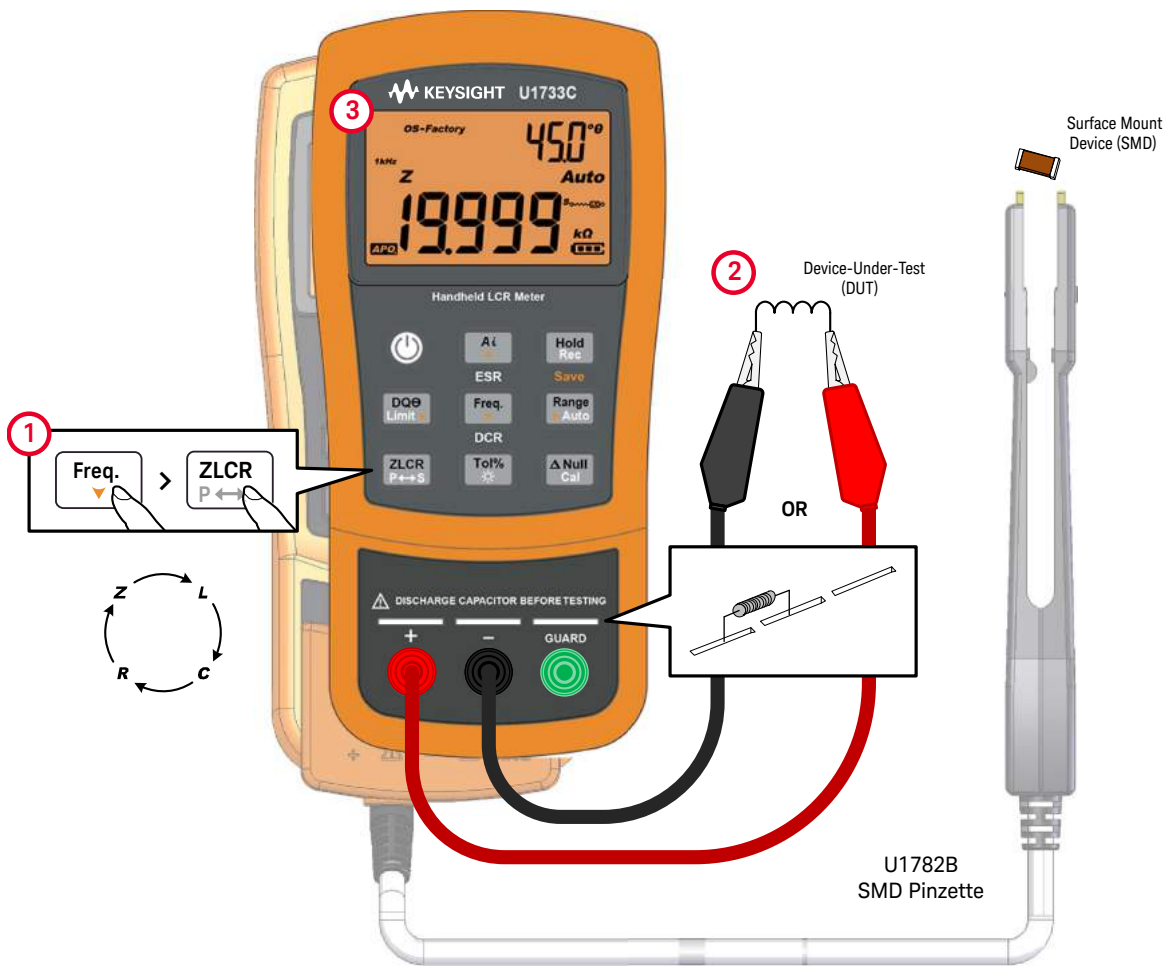



Abbildung 2-9 Messen der Impedanz

Messen von Ableitungsfaktor/Qualitätsfaktor/Phasenwinkel (D/Q/θ)

Die Werte für Ableitungsfaktor (D), Qualitätsfaktor (Q) und Phasenwinkel (θ) können abwechselnd angezeigt werden, indem Sie auf die Taste  drücken, wenn das LCR-Messgerät auf den Induktivitäts-, Kapazitäts- oder Impedanzmessungsmodus eingestellt ist.

Diese Einstellung ist für DCR-Messung nicht anwendbar.

Ändern der Testfrequenz



Standardmäßig ist für die Testfrequenz 1 kHz festgelegt. Drücken Sie die Taste , um die gewünschte Testfrequenz auszuwählen.

Tabelle 2-5 Verfügbare Testfrequenzen

Modell	100 Hz	120 Hz	1 kHz	10 kHz	100 kHz
U1731C	✓	✓	✓	-	-
U1732C	✓	✓	✓	✓	-
U1733C	✓	✓	✓	✓	✓

Auswählen des Parallel-/Serienschaltkreismodus (P/S)


das LCR-Messgerät kann Parallelmodusdaten () oder Serienmodusdaten () für alle Bereiche anzeigen.


Drücken Sie die Taste  mindestens eine Sekunde, um zwischen Parallel- und Serienmodus umzuschalten.

Der Serienmodus ist beim Einschalten standardmäßig eingestellt. Sie können dieses Einschaltverhalten aber im Setup-Menü ändern. Weitere Informationen zum Ändern des standardmäßigen Messmodus (parallel oder Serien) bei zukünftigen Einschaltvorgängen finden Sie unter „Ändern des Verhaltens beim Einschalten“ auf Seite 70.

Einstellen der Standardreferenztoleranz (Tol%)

Die verfügbaren Toleranzbereiche liegen bei 1%, 5%, 10% und 20%.

Um in den Toleranzmodus zu wechseln, setzen Sie die entsprechende Komponente als Standardwert in die Buchse ein oder Sie verbinden die Komponente mit den Testsonden. Drücken Sie dann die Taste , um diesen Wert als Standardreferenztoleranz festzulegen.

Ähnlich kann jeder beliebige, auf der Anzeige dargestellte Wert wie beispielsweise HOLD oder Max/Min/Avg (Rec) als Standardwert für die Klassifikation von Komponenten verwendet werden. Drücken Sie erneut auf , um Ihrem Bedarf entsprechend 1%, 5%, 10% und 20% für die Toleranz festzulegen.

Diese Funktion wurde entwickelt, um Komponenten einfach klassifizieren zu können. Das akustische Signal ertönt drei Mal, wenn die getestete Komponente die festgelegte Toleranz überschreitet. Wenn das akustische Signal hingegen nur einmal ertönt, weist dies darauf hin, dass sich die Komponente innerhalb der festgelegten Toleranz bewegt.

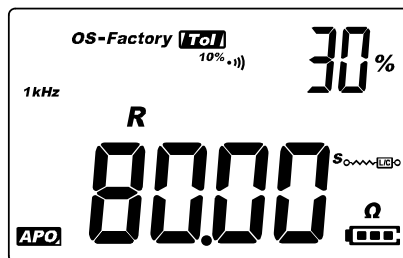




Abbildung 2-10 Komponente überschreitet die eingestellte Toleranz

HINWEIS

- Der Toleranzmodus kann nicht aktiviert werden, wenn  in der Anzeige angezeigt wird oder wenn der getestete Kapazitätswert unter 50 Zählern liegt.
- Der Toleranzmodus ist nur in der manuellen Bereichsauswahl verfügbar. Bei Aktivierung in der automatischen Bereichsauswahl wird für das LCR-Messgerät automatisch die manuelle Bereichsauswahl festgelegt.

Aktivieren von ESR-Messungen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf , um die ESR-Messung einzustellen. Verwenden Sie die ESR-Messung, um den äquivalenten Serienwiderstand (ESR) des Kondensators unabhängig von seiner Kapazität zu messen.

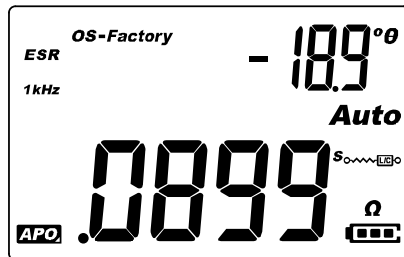



Abbildung 2-11 ESR-Messung mit Theta

Drücken Sie länger als 1 Sekunde auf , um diesen Modus zu beenden.

Aktivieren von DCR-Messungen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf , um die DCR-Messung einzustellen. Die DCR-Messung misst den Widerstand in einer unbekannt Komponente mit 1 V Gleichstrom.

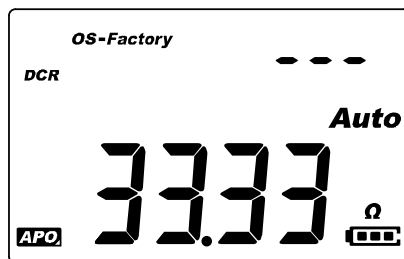



Abbildung 2-12 DCR-Messung

Drücken Sie länger als 1 Sekunde auf , um diesen Modus zu beenden.

Zusätzliche Funktionen

Sperren der Anzeige (Hold)

Drücken Sie zum Sperren der Anzeige für jede Funktion auf die Taste . Das Anzeigesymbol **Hold** wird angezeigt, wenn die Einfrierfunktion (Hold) aktiv ist.

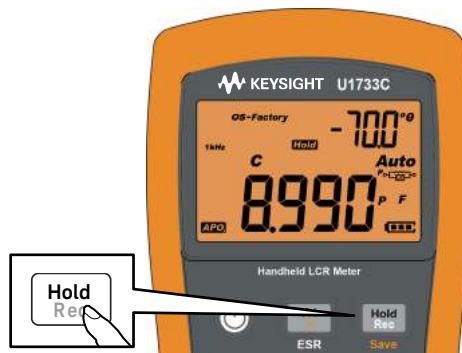



Abbildung 2-13 Verwenden der Hold-Funktion

Drücken Sie erneut auf , um den Messwert zu aktualisieren, sobald dieser stabil ist. Das Anzeigesymbol **Hold** blinkt, während auf einen stabilen Messwert gewartet wird.

Drücken Sie länger als 1 Sekunde auf , um die Hold-Funktion zu deaktivieren.


Aktivieren des statischen Aufzeichnungsmodus (Rec)

Der statische Aufzeichnungsmodus speichert Maximum-, Minimum- und Durchschnittswerte während einer Messserie im Speicher des LCR-Messgeräts.

Wenn das Eingangssignal unter dem aufgezeichneten Minimumwert oder über dem aufgezeichneten Maximumwert liegt, gibt das LCR-Messgerät einen Ton aus und erfasst den neuen Wert. Das LCR-Messgerät berechnet auch einen Durchschnitt aller Messwerte, die seit der Aktivierung des statischen Aufzeichnungsmodus gemessen wurden.

In der Anzeige des LCR-Messgeräts können Sie die folgenden statistischen Daten für alle Messwerte anzeigen lassen:

- Max: höchster Messwert seit Aktivieren des statischen Aufzeichnungsmodus
- Min: niedrigster Messwert seit Aktivieren des statischen Aufzeichnungsmodus
- Avg: Durchschnittswert aller Messwerte seit Aktivierung des statischen Aufzeichnungsmodus
- MaxMinAvg: aktueller Messwert (Wert des tatsächlichen Eingangssignals)

Drücken Sie länger als eine Sekunde auf , um den statischen Aufzeichnungsmodus aufzurufen.

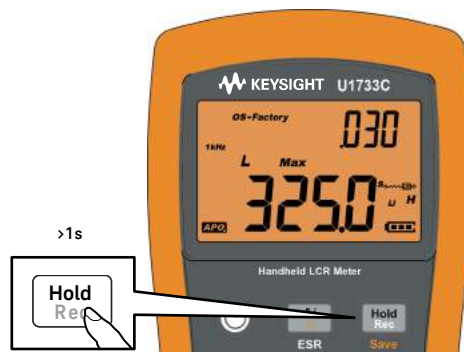



Abbildung 2-14 Verwenden der Rec-Funktion

Drücken Sie erneut auf , um in den Eingangswerten für Max, Min, Avg oder MaxMinAvg (aktuell) zu navigieren.

Um diesen Modus zu beenden, drücken Sie die Taste  und halten sie für mindestens eine Sekunde gedrückt.

HINWEIS

- Bei der statischen Aufzeichnung werden nur stabile Werte und Aktualisierungen im Speicher aufgezeichnet. Überspannungswerte (\overline{U}) werden für keine der LCR-Funktionen aufgezeichnet. Darüber hinaus zeichnet das LCR-Messgerät bei Kapazitätsmessungen unter 50 Zählern keine Werte auf.
- Der statische Aufzeichnungsmodus ist nur in der manuellen Bereichsauswahl verfügbar. Wenn Sie in der automatischen Bereichsauswahl den statischen Aufzeichnungsmodus auswählen, wird für das LCR-Messgerät automatisch die manuelle Bereichsauswahl festgelegt

Einstellen des Abgleichs für oberen/unteren Grenzwert (Grenze)

Die Funktion für das Abgleichen des oberen/unteren Grenzwerts unterstützt Sie beim Klassifizieren der Komponenten. Es sind 32 Grenzsätze verfügbar (16 feste werkseitige Sätze und 16 variable Benutzersätze)

Das LCR-Messgerät verwendet standardmäßig die werkseitig eingestellten Sätze. Sie können beim Einschalten im Setup-Menü festlegen, dass das LCR-Messgerät die Benutzersätze verwenden soll. In „Ändern der beim Einschalten aktiven Grenzwertkategorie und des Satzes“ auf Seite 79 erhalten Sie weitere Informationen.

In **Tabelle 2-6** sind die werkseitig voreingestellten Grenzwerte für jeden Satz angegeben.

Tabelle 2-6 Werkseitig voreingestellte obere und untere Grenzwerte


Satz	Oberer Grenzwert (H)	Unterer Grenzwert (L)
F01	1000	900
F02	1200	1080
F03	1500	1350
F04	1800	1620
F05	2200	1980
F06	2700	2430
F07	3300	2970
F08	3900	3510

Tabelle 2-6 Werkseitig voreingestellte obere und untere Grenzwerte (Fortsetzung)

Satz	Oberer Grenzwert (H)	Unterer Grenzwert (L)
F09	4700	4230
F10	5600	5040
F11	6800	6120
F12	8200	7380
F13	10000	9000
F14	12000	10800
F15	15000	13500
F16	18000	16200

HINWEIS

Die Standardwerte der variablen Benutzersätze sind auf die gleichen Werte voreingestellt wie die festen Benutzersätze. Sie können diese oberen und unteren Grenzwerte im Setup-Menü ändern. In „Ändern der benutzerdefinierten Werte für oberen/unteren Grenzwert“ auf Seite 80 erhalten Sie weitere Informationen.

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die Taste , um den Modus für oberen/unteren Grenzwert zu aktivieren. Die letzte bekannte Satznummer (H## oder L##) wird in der Sekundäranzeige angezeigt.

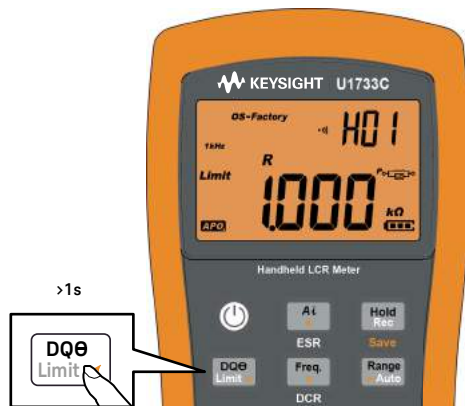




Abbildung 2-15 Verwenden der Grenzwertfunktion

Wählen Sie, während die Symbolanzeige **Limit** blinkt mit den Tasten  oder  einen geeigneten Grenzwertsatz aus.

Sie können erneut auf  oder  drücken, um zwischen den in der Primärazeige angezeigten Werten für Obergrenze (H) und Untergrenze (L) umzuschalten.

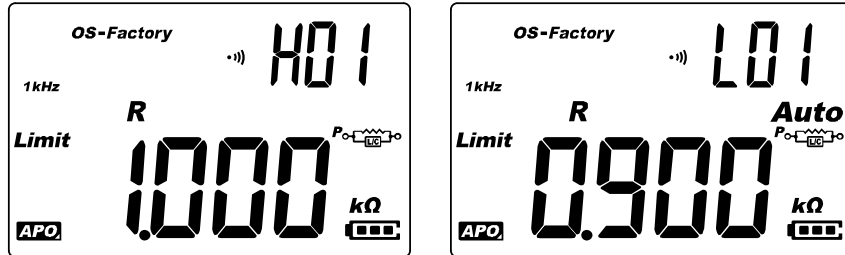



Abbildung 2-16 Obere und untere Grenzwerte

Drücken Sie auf , während die Symbolanzeige **Limit** blinkt, um den Abgleich zu starten. (Wenn nach 3 Sekunden keine Aktivität gemessen wird, beginnt der Abgleich ebenfalls.)

Das LCR-Messgerät gibt drei akustische Signale aus und in der Sekundärazeige wird **nGo** angezeigt, wenn der Messwert größer (\blacktriangle) als der obere Grenzwert oder kleiner (\blacktriangledown) als der untere Grenzwert ist.

Wenn der Messwert innerhalb der beiden Grenzwerte liegt, wird 1 akustisches Signal ausgegeben, und in der Sekundärazeige wird **Go** angezeigt.

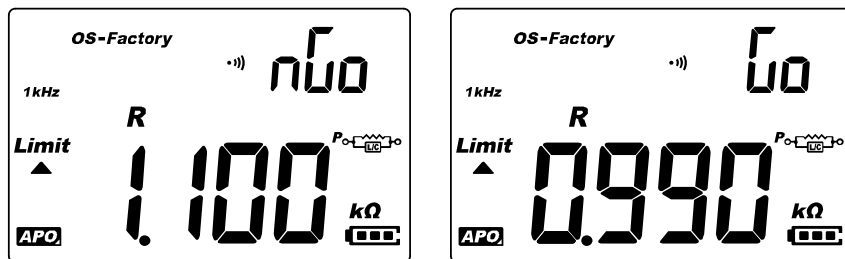



Abbildung 2-17 Anzeigen „nGo“ und „Go“

Der im Abgleich verwendete Grenzwertsatz wird nach der Anzeige $n\Omega_0/\Omega_0$ angegeben.

Drücken und halten Sie  länger als 1 Sekunde, um diesen Modus zu beenden.

Durchführen relativer Messungen (Null)

Bei relativen Messungen, die auch als Nullmessungen bezeichnet werden, zeigt jeder Messwert den Unterschied zwischen einem gespeicherten (ausgewählten oder gemessenen) Relativwert und dem Eingangssignal.

Ein möglicher Anwendungsbereich ist das Verbessern der Genauigkeit von Widerstandsmessungen durch Nullsetzen der Testleitungswiderstände (Testleitungen kurzgeschlossen). Die Nullsetzung der Testleitungen ist vor der Durchführung von Kapazitätsmessungen ebenfalls besonders wichtig (Testleitungen offen).





Drücken Sie die Taste , um in den relativen Modus zu wechseln und den angezeigten Messwert als Referenzwert zu speichern. Daraufhin werden alle nachfolgenden Messwerte im Verhältnis zum Referenzwert angezeigt.



Abbildung 2-18 Verwenden der Nullfunktion

Das Anzeigensymbol  wird angezeigt, während der relative Modus aktiv ist. Drücken Sie erneut auf , um den relativen Modus zu verlassen.


HINWEIS

- Der relative Modus kann nicht aktiviert werden, wenn der Anzeigewert  lautet.
- Der relative Modus ist nur in der manuellen Bereichsauswahl verfügbar. Bei Aktivierung in der automatischen Bereichsauswahl wird für das LCR-Messgerät automatisch die manuelle Bereichsauswahl festgelegt.
- Der relative Modus kann nicht aktiviert werden, wenn die automatische Bereichsauswahl mit dem Datenhaltemodus aktiviert ist.

Ausführen der Open/Short-CAL

Die CAL-Funktion versetzt (korrigiert) sowohl die internen Parameter des LCR-Messgeräts als auch die Restwerte des externen Anschlusses für die weitere Messung. Diese Aktion hilft Ihnen, den Einfluss für vorübergehende Verwendungen zu korrigieren.

Es sind drei Arten von Open/Short-CAL verfügbar:

- OS-Factory: Open/Short-CAL wird im Werkskalibrierungsmodus durchgeführt (geschützt durch Sicherheitscode). Sie deckt alle Frequenzen und Bereiche ab.
- OS-User: Open/Short-CAL wird bei jedem Einschaltoptionsintervall durchgeführt. Sie deckt alle Frequenzen und Bereiche ab. (OS-Benutzer-Setup siehe [Seite 27](#)).
- Open/Short-CAL für einzelnen Bereich und einzelne Frequenz durch Drücken und Halten der Taste  für mehr als 1 Sekunde.

Die Korrekturen für **OS-Factory** und **OS-User** sind im LCR-Messgerät standardmäßig gespeichert. Sie werden beide an den Anschlussenden kalibriert.

Sie können das LCR-Messgerät so einstellen, dass es die Open/Short-CAL **OS-Factory** oder **OS-User** verwendet. Dies können Sie im Setup-Menü einstellen (siehe [Seite 76](#)).

Die Open/Short-CAL-Funktion ist für feste Messbereiche verfügbar.

HINWEIS

Die Open/Short-CAL sollte unbedingt vor Präzisionsmessungen durchgeführt werden.



Abbildung 2-19 Verwenden der Cal-Funktion

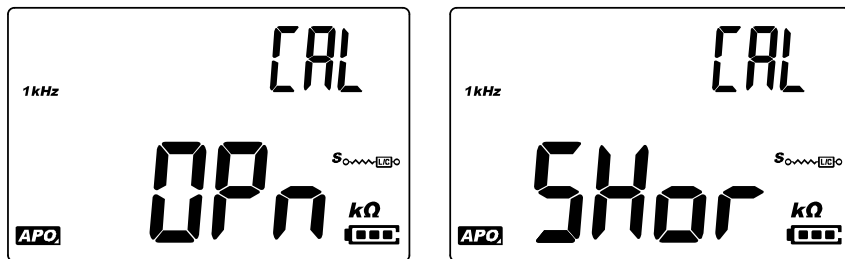




Abbildung 2-20 Aufforderungen für offene Kalibrierung und Kurzschlusskalibrierung

2 Merkmale und Funktionen

- 1 Drücken Sie die Taste  und halten Sie diese für mindestens 1 Sekunde gedrückt, um den Open/Short-CAL-Modus für die ausgewählte Frequenz und den ausgewählten Bereich zu aktivieren.
- 2 Open/Short-CAL-Eingabeaufforderungen werden in der Anzeige angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen für offene Anschlüsse (**OPn**) und kurzgeschlossene Anschlüsse (**SHor**) und drücken Sie die Taste .
Die **CAL**-Anzeige oben rechts in der Anzeige blinkt und zeigt an, dass die Korrektur durchgeführt wird.
- 3 Nachdem die Open/Short-CAL abgeschlossen ist, wird die Anzeige des LCR-Messgeräts wieder in den normalen Modus zurückgesetzt, und das Messgerät ist bereit zur normalen Verwendung.

3 Setup-Optionen

Verwenden des Menüs „Setup“	66
Zusammenfassung - Menü „Setup“	68
Setup-Menüelemente	70

Im folgenden Kapitel wird beschrieben, wie Sie die voreingestellten Einstellungen des LCR-Messgeräts ändern können.


















Verwenden des Menüs „Setup“

Im Menü „Setup“ können Sie mehrere nichtflüchtige Voreinstellungen ändern. Das Ändern dieser Einstellung hat Auswirkungen auf den allgemeinen Betrieb verschiedener Funktionen des LCR-Messgeräts. Wählen Sie eine zu bearbeitende Einstellung aus und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:



- Wechseln zwischen zwei Werten, beispielsweise Ein oder Aus
- Navigieren durch mehrere Werte aus einer vordefinierten Liste
- Erhöhen oder Verringern eines numerischen Wertes innerhalb eines festgelegten Bereichs



Der Inhalt des Setup-Menüs wird in [Tabelle 3-2](#) auf Seite 68 zusammengefasst.

Tabelle 3-1 Menü „Setup“ - Hauptfunktionen



Legende	Beschreibung
	Drücken Sie auf  und halten Sie die Taste gedrückt, während Sie das LCR-Messgerät einschalten (⏻), um auf das Setup-Menü zuzugreifen. Drücken und halten Sie  länger als 1 Sekunde, um diesen Modus zu beenden.
 	Drücken Sie auf  oder  , um zwischen den Menüelementen zu wechseln.
 	Drücken Sie bei jedem Menüelement auf  oder  , um die Voreinstellungen zu ändern. Das Menüelement (in der Sekundäranzeige) blinkt. Dies weist darauf hin, dass Sie nun die Werte der Menüelemente ändern können. Drücken Sie erneut auf  oder  , um zwischen den Werten umzuschalten, um durch mehrere Werte einer Liste zu navigieren oder um einen numerischen Wert zu erhöhen oder zu verringern.
 	Drücken Sie auf  , während das Menüelement blinkt, um die Änderungen zu speichern. Drücken Sie auf  , während das Menüelement blinkt, um die Änderungen zu verwerfen.



Bearbeiten von numerischen Werten

Verwenden Sie beim Bearbeiten von numerischen Werten die Tasten  und , um den Zeiger auf einer Ziffer zu positionieren.

- Drücken Sie auf , um den Zeiger nach links zu verschieben.
- Drücken Sie auf , um den Zeiger nach rechts zu verschieben.

Wenn der Zeiger auf einer Ziffer positioniert ist, können Sie mit  und  die Ziffer ändern.

- Drücken Sie auf , um die Ziffer zu erhöhen.
- Drücken Sie auf , um die Ziffer herabzusetzen.

Wenn Sie die Änderungen abgeschlossen haben, speichern Sie den numerischen Wert, indem Sie auf  drücken. (Alternativ können Sie durch Drücken auf  die Änderungen verwerfen.)

Zusammenfassung - Menü „Setup“

In folgender Tabelle sind die Elemente des Setup-Menüs zusammengefasst. Klicken Sie auf die Seiten „Weitere Informationen“, um weiterführende Informationen zu den Menüelementen zu erhalten.

Tabelle 3-2 Elementbeschreibungen für das Setup-Menü

Legende	Verfügbare Einstellungen	Beschreibung	Weitere Informationen zu:
P_{on} TYPE	A_i , Z, L, C, R, ESR oder DCR	Einstellen des Messtyps, der beim Einschalten des LCR-Messgeräts aktiv ist. Standardmäßig ist dies der automatische Identifizierungsmodus (A_i).	Seite 70
P_{on} FREQ	100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz oder 100 kHz	Einstellen der Testfrequenz, die beim Einschalten des LCR-Messgeräts aktiv ist. Standardmäßig ist dies 1 kHz.	Seite 72
P_{on} L Auto	D, Q oder θ und P oder S	Einstellen der Sekundärparameter und des Messungsmodus für Induktivität (L), die beim Einschalten des LCR-Messgeräts aktiv sind. Standardmäßig sind Qualitätsfaktor (Q) und Serien (S).	Seite 73
P_{on} C Auto	D, Q oder θ und P oder S	Einstellen der Sekundärparameter und des Messungsmodus für Kapazität (C), die beim Einschalten des LCR-Messgeräts aktiv sind. Standardmäßig sind Ableitungsfaktor (D) und Serien (S).	Seite 74
P_{on} R Auto	D, Q oder θ und P oder S	Einstellen der Sekundärparameter und des Messungsmodus für Widerstand (R), die beim Einschalten des LCR-Messgeräts aktiv sind. Standardmäßig ist dies Phasenwinkel (θ) und Serien (S).	Seite 75
αSC FACT	FACT oder USER	Einstellen des Open/Short-CAL-Modus, der beim Einschalten des LCR-Messgeräts aktiv ist. Standardmäßig ist dies „FACT“ (werkseitig).	Seite 76
R_i IO	05° bis 45°	Einstellen der Phasenwinkelbedingung für den autom. Identifizierungsmodus (A_i). Standard ist 10°.	Seite 77

Tabelle 3-2 Elementbeschreibungen für das Setup-Menü (Fortsetzung)

Legende	Verfügbare Einstellungen	Beschreibung	Weitere Informationen zu:
^{Pon} Ft01	Ft01 bis Ft16 oder Ur01 bis Ur16	Einstellen der Grenzwertkategorie (werkseitig oder benutzerdefiniert) und des Satzes (01 bis 16), die beim Einschalten des LCR-Messgeräts aktiv sind. Standardmäßig ist dies Ft01.	Seite 79
^{HO1} 1000	H01 bis H16 oder L01 bis L16 0 bis 19999	Einstellen des oberen und unteren Grenzwerts für jeden variablen Benutzersatz Die standardmäßigen Benutzerwerte finden Sie in Tabelle 3-4 auf Seite 80.	Seite 80
^{bPS} 9600	9600 oder 19200	Einstellen der Baudrate für die Fernkommunikation mit einem PC (9600 oder 19200) Standard ist 9600.	Seite 82
^{PAR} nonE	En, nonE oder odd	Einstellen des Prüfbits für die Fernkommunikation mit einem PC (gerade, keine oder ungerade) Standard ist „Keine“	Seite 83
^{dRt} 8bit	7-Bit oder 8-Bit	Einstellen der Datenbitlänge für die Fernkommunikation mit einem PC (7-Bit oder 8-Bit) Standard sind 8-Bit.	Seite 84
^{bEP} 4000	2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, Hz oder AUS	Einstellen der Frequenz des akustischen Signals des LCR-Messgeräts (2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, Hz oder AUS) Standard ist 4000 Hz.	Seite 85
^{LPb} oFF	oFF oder on	Sperren der Drucktasten des LCR-Messgeräts Standardmäßig ausgeschaltet.	Seite 86
^{APo} 05	01 bis 99 Min. oder „oFF“	Einstellen der Energie-Timeout-Dauer von 1 bis 99 Minuten (1 Stunde, 39 Minuten) oder ausschalten. Standard sind 5 Minuten.	Seite 87
^{bLt} 30	01 bis 99 Sek. oder „oFF“	Einstellen der LCD-Hintergrundbeleuchtungsdauer von 1 bis 99 Sekunden (1 Minute, 39 Sekunden) oder ausschalten. Standard sind 30 Sekunden.	
^{rSt} dEFA	dEFA	Zurücksetzen des LCR-Messgeräts auf die voreingestellten Werkseinstellungen.	Seite 88

Setup-Menüelemente

Ändern des Verhaltens beim Einschalten

Sie können das Einschaltverhalten des LCR-Messgeräts für zukünftige Einschaltvorgänge ändern.

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
Pon-tYPE	A_i , Z, L, C, R, ESR oder DCR	A_i
Pon-FrEq	100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz oder 100 kHz	1 kHz
Pon-AUto (L)	- D, Q oder θ - Parallel oder Serien	- Q - Serie
Pon-AUto (C)	- D, Q oder θ - Parallel oder Serien	- D - Serie
Pon-AUto (R)	- D, Q oder θ - Parallel oder Serien	- θ - Serie
Pon-oSC	FAcT oder USEr	FAcT

Ändern des Messtyps beim Einschalten

Mit diesem Setup-Element können Sie den Messtyp beim Einschalten des LCR-Messgeräts ändern. Sie haben hierfür folgende Messtypen zur Auswahl:

- Autom. Identifizierungsmodus (A_i)
- Impedanzmessung (Z)
- Induktivitätsmessung (L)
- Kapazitätsmessung (C)
- Widerstandsmessung (R)
- Äquivalenter Serienwiderstandsmodus (RES)
- Gleichstromwiderstandsmodus (DCR) (nur U1733C)

Das LCR-Messgerät wird bei den nächsten Einschaltvorgängen im ausgewählten Modus gestartet.



Abbildung 3-1 Ändern des Messtyps beim Einschalten

Ändern der Testfrequenz beim Einschalten

Mit diesem Setup-Element können Sie die anfängliche Testfrequenz des LCR-Messgeräts ändern. Sie können das LCR-Messgerät so einstellen, dass es mit einer Testfrequenz zwischen 100 Hz und 100 kHz beginnt.

Das LCR-Messgerät wird beim Einschalten immer die ausgewählte Testfrequenz verwenden.

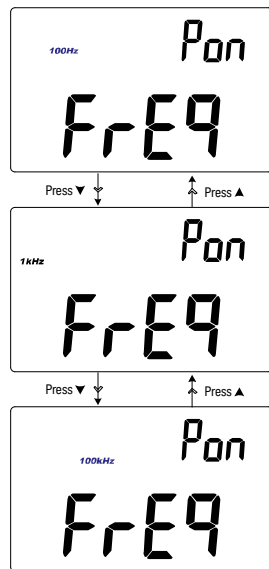


Abbildung 3-2 Ändern der Testfrequenz beim Einschalten

Ändern der beim Einschalten aktiven Sekundärparameter und des Messmodus für Induktivitätsmessungen (L)

Verwenden Sie dieses Setup-Element, um für die Induktivitätsmessung (**L**) die anfänglichen Sekundärparameter – Ableitungsfaktor (**D**), Qualitätsfaktor (**Q**) oder Phasenwinkel (θ) – und den Messmodus – parallel oder Serien – zu ändern.

Die Induktivitätsmessung (**L**) startet dann beim Einschalten immer unter Verwendung der ausgewählten Sekundärparameter und des ausgewählten Messmodus.

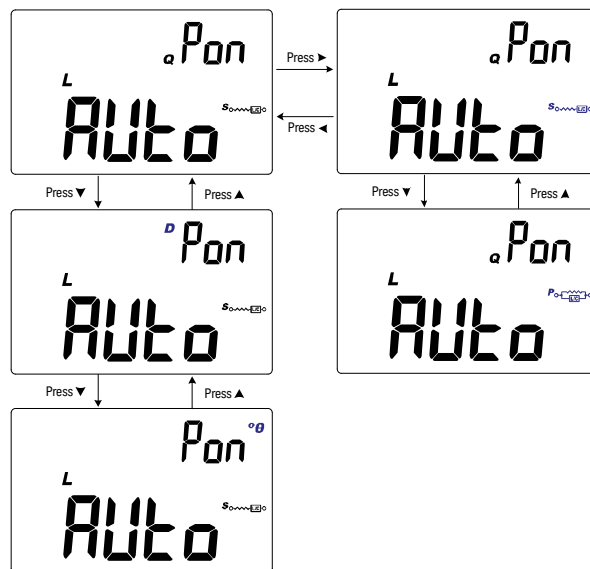


Abbildung 3-3 Ändern der beim Einschalten aktiven Sekundärparameter und des Messmodus für Induktivitätsmessungen (L)

Ändern der beim Einschalten aktiven Sekundärparameter und des Messmodus für Kapazitätsmessungen (C)

Verwenden Sie dieses Setup-Element, um für die Kapazitätsmessung (C) die anfänglichen Sekundärparameter – Ableitungsfaktor (D), Qualitätsfaktor (Q) oder Phasenwinkel (θ) – und den Messmodus – parallel oder Serien – zu ändern.

Die Kapazitätsmessung (C) startet dann beim Einschalten immer unter Verwendung der ausgewählten Sekundärparameter und des ausgewählten Messmodus.

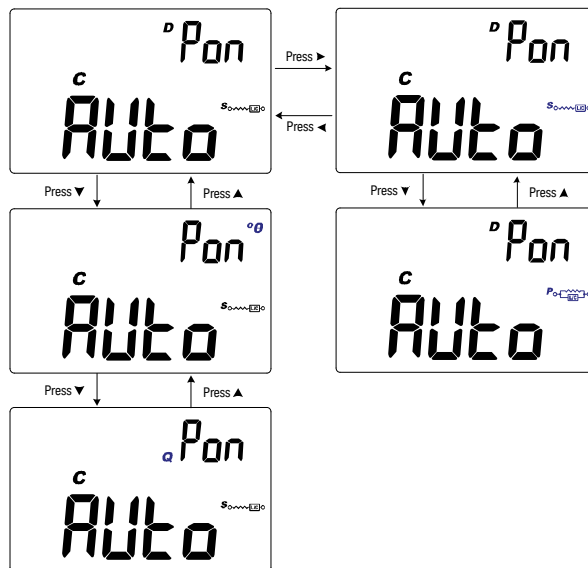


Abbildung 3-4 Ändern der beim Einschalten aktiven Sekundärparameter und des Messmodus für Kapazitätsmessungen (C)

Ändern der beim Einschalten aktiven Sekundärparameter und des Messmodus für Widerstandsmessungen (R)

Verwenden Sie dieses Setup-Element, um für die Widerstandsmessung (**R**) die anfänglichen Sekundärparameter – Ableitungsfaktor (**D**), Qualitätsfaktor (**Q**) oder Phasenwinkel (θ) – und den Messmodus – parallel oder Serien – zu ändern.

Die Widerstandsmessung (**R**) startet dann beim Einschalten immer unter Verwendung der ausgewählten Sekundärparameter und des ausgewählten Messmodus.

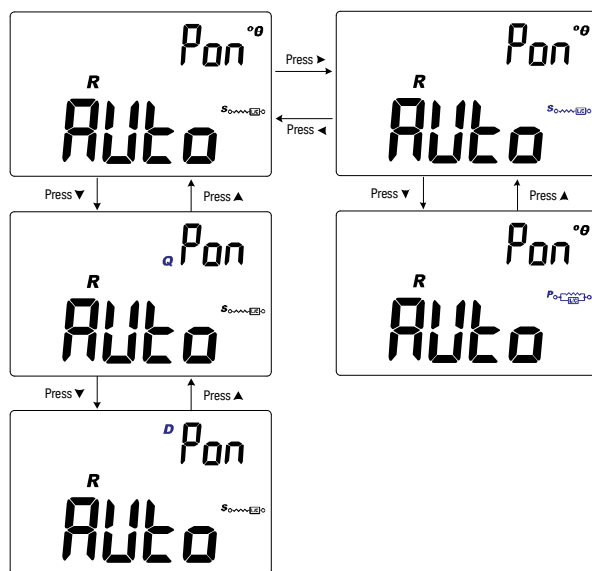


Abbildung 3-5 Ändern der beim Einschalten aktiven Sekundärparameter und des Messmodus für Widerstandsmessungen (R)

Ändern der Open/Short-CAL beim Einschalten

Verwenden Sie dieses Setup-Element, um die anfängliche Open/Short-CAL des LCR-Messgeräts entweder auf die werkseitig voreingestellte Open/Short-CAL (**FACT**) oder auf die benutzerdefinierte Open/Short-CAL (**USER**) festzulegen.

Das LCR-Messgerät wird beim Einschalten immer die ausgewählte Open/Short-CAL verwenden.

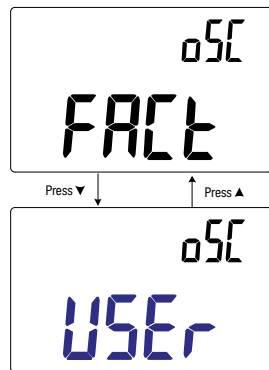


Abbildung 3-6 Ändern der Open/Short-CAL beim Einschalten

Ändern der Phasenwinkelbedingung der A_i -Funktion

Diese Einstellung wird mit der A_i -Funktion verwendet (Siehe Seite 42). Die Funktion A_i hilft dabei, L-, C- oder R-Messungen automatisch entsprechend dem im Messobjekt ermittelten Impedanzwinkel auszuwählen.

Verwenden Sie dieses Setup-Element, um den Standardphasenwinkel für die A_i -Funktion im Bereich zwischen 5° und 45° zu ändern.

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
A_i	(5 bis 45°)	10°

In [Tabelle 3-3](#) wird die Beziehung zwischen dem festgestellten Phasenwinkel und den ausgewählten L-, C- und R-Messungen angezeigt.

Tabelle 3-3 Automatische Identifizierung - Phasenwinkelregeln

Phasenwinkel ^[1]	Primäranzeige	Sekundäranzeige
$-\text{Set} < \theta < +\text{Set}$	R	θ
$\theta \geq +\text{Set}$	L	Q
$\theta \leq -\text{Set}$	C	D

[1] Wobei $\pm\text{Set}$ der ausgewählte Phasenwinkel ist.

3 Setup-Optionen

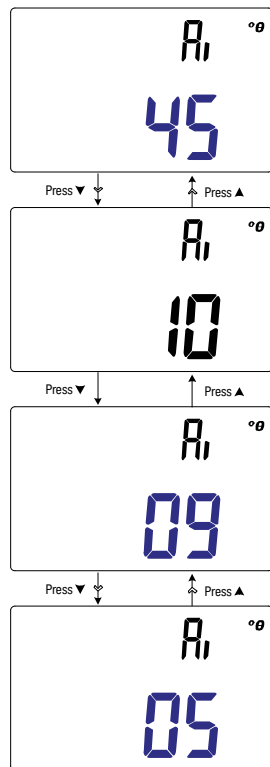


Abbildung 3-7 Ändern der Phasenwinkelbedingung der A_i -Funktion

Ändern der beim Einschalten aktiven Grenzwertkategorie und des Satzes

Diese Einstellung wird mit der Grenzwertabgleichsfunktion verwendet (Seite 58)
Es sind 32 Grenzsätze verfügbar (16 feste werkseitige Sätze und 16 variable Benutzersätze)

Mit diesem Setup-Element können Sie die voreingestellte Kategorie (Werkseinstellung oder Benutzer) und den Satz (1 bis 16) für zukünftige Einschaltvorgänge ändern.

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
Pon	<ul style="list-style-type: none"> - Werkseinstellung (Ft01 bis Ft16) oder - Benutzer (Ur01 bis Ur16) 	Ft01

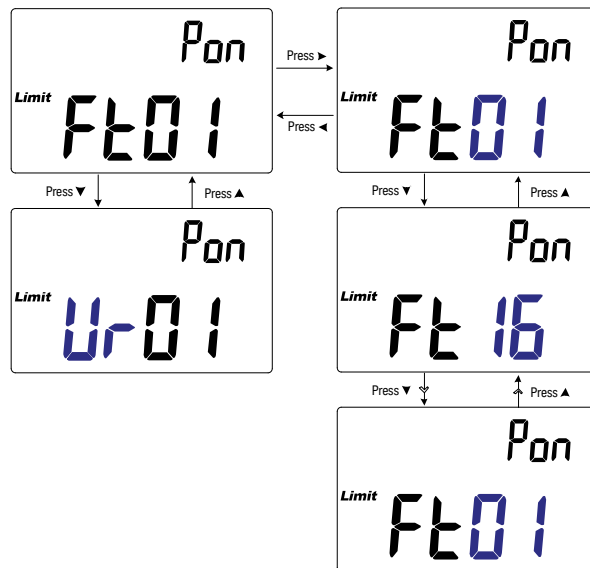


Abbildung 3-8 Ändern des beim Einschalten aktiven Grenzwert- und Kategoriesatzes

Ändern der benutzerdefinierten Werte für oberen/unteren Grenzwert

Diese Einstellung wird mit der Grenzwertabgleichsfunktion verwendet (Seite 58). Es sind 16 variable Benutzersätze verfügbar.

Mit diesem Setup-Element können Sie die oberen und unteren Grenzwerte eines jeden variablen Benutzersatzes ändern.

HINWEIS

Der untere Grenzwert kann von 0 bis „kleiner oder gleich“ dem oberen Grenzwert angegeben werden. Der obere Grenzwert kann von „mehr als oder gleich“ dem unteren Grenzwert bis „kleiner als oder gleich“ dem maximalen Anzeigezähler (19999) eingestellt werden.

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
- H(01 bis 16) oder - L(01 bis 16)	0 bis 19999	Siehe Tabelle 3-4

In [Tabelle 3-4](#) sind die benutzerdefinierten Standardgrenzwerte für jeden Satz angegeben.

Tabelle 3-4 Benutzerdef. obere/untere Standardgrenzwerte

Satz	Oberer Grenzwert (H)	Unterer Grenzwert (L)
U01	1000	900
U02	1200	1080
U03	1500	1350
U04	1800	1620
U05	2200	1980
U06	2700	2430
U07	3300	2970
U08	3900	3510
U09	4700	4230
U10	5600	5040

Tabelle 3-4 Benutzerdef. obere/untere Standardgrenzwerte (Fortsetzung)

Satz	Oberer Grenzwert (H)	Unterer Grenzwert (L)
U11	6800	6120
U12	8200	7380
U13	10000	9000
U14	12000	10800
U15	15000	13500
U16	18000	16200

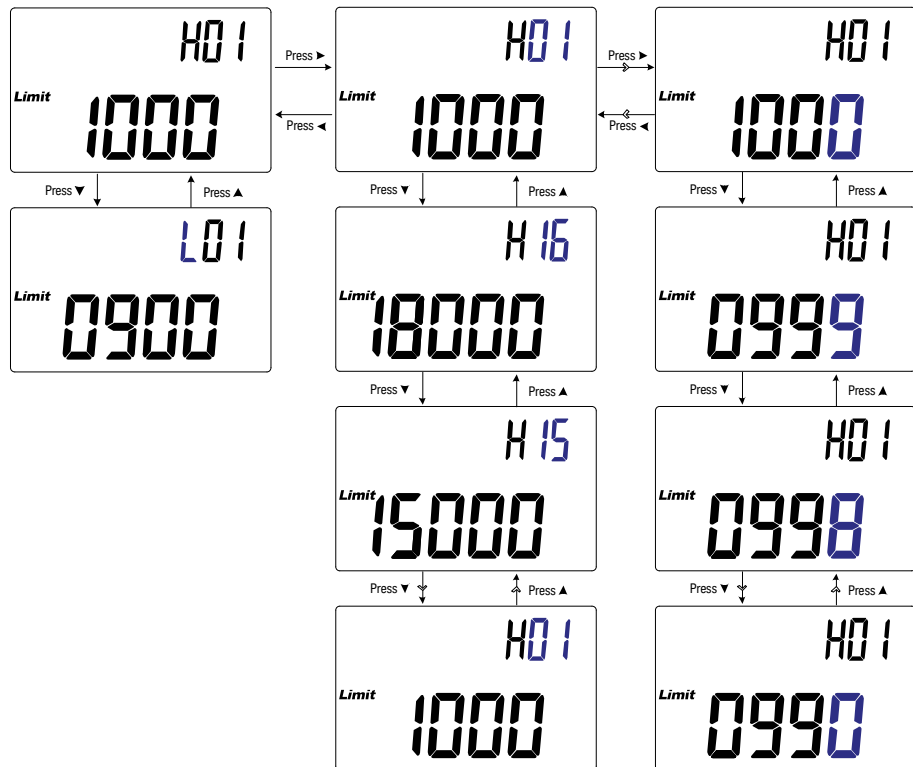


Abbildung 3-9 Ändern der benutzerdefinierten Werte für oberen/unteren Grenzwert

Ändern der Baudrate

Diese Einstellung wird mit dem IR-Kommunikationsanschluss und der Keysight GUI Data Logger-Software verwendet, um das LCR-Messgerät ferngesteuert zu bedienen ([Seite 26](#)).

Mit diesem Setup-Element können Sie die Baudrate für die Fernsteuerung mit einem PC ändern.

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
bPS	(9600 oder 19200) Bits/Sekunde	9600 Bits/Sekunde

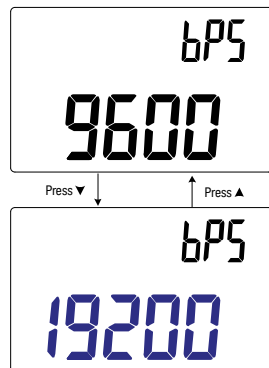


Abbildung 3-10 Ändern der Baudrate

Ändern der Paritätsprüfung

Diese Einstellung wird mit dem IR-Kommunikationsanschluss und der Keysight GUI Data Logger-Software verwendet, um das LCR-Messgerät ferngesteuert zu bedienen (Seite 26).

Mit diesem Setup-Element können Sie die Paritätsprüfung für die Fernsteuerung mit einem PC ändern.

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
PA _r	nonE, En oder odd	nonE



Abbildung 3-11 Ändern der Paritätsprüfung

Ändern der Datenbits

Diese Einstellung wird mit dem IR-Kommunikationsanschluss und der Keysight GUI Data Logger-Software verwendet, um das LCR-Messgerät ferngesteuert zu bedienen (Seite 26).

Mit diesem Setup-Element können Sie die Datenbitanzahl (Datenbreite) für die Fernkommunikation mit einem PC ändern. Die Anzahl des Stopbits ist immer 1 und kann nicht geändert werden.

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
dAt	7 Bits oder 8 Bits	8-bit

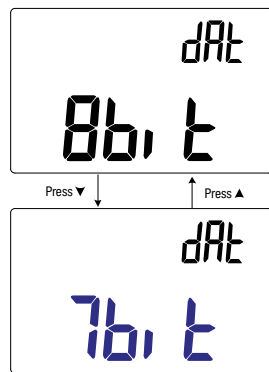


Abbildung 3-12 Ändern der Datenbits

Ändern der Warntonfrequenz

Das akustische Signal des LCR-Messgeräts warnt Benutzer bei neu erfassten Werten für statische Aufzeichnungen, bei erfassten Werten, die außerhalb der eingestellten Toleranz oder Grenzwerte liegen und bei ungültigen Tastenoperationen.

Mit diesem Setup-Element können Sie die Frequenz des akustischen Signals ändern.

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
bEP	(2000, 3000, 4000) Hz oder oFF	4000 Hz



Abbildung 3-13 Ändern der Warntonfrequenz

Sperren der Drucktasten

Mit diesem Setup-Element können Sie die Drucktasten des LCR-Messgeräts sperren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, sind alle Tasten gesperrt (die Funktionen ist nicht verfügbar), wenn Sie das Setup-Menü verlassen.

Sie können die Tasten wieder aktivieren, wenn Sie das Setup-Menü über die Einschaltoptionen wieder öffnen ([Seite 27](#)).

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
LPb	on oder oFF	oFF

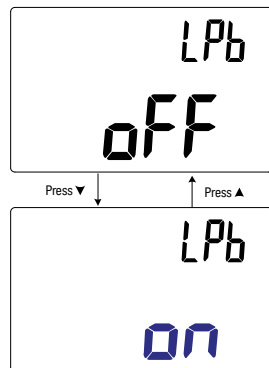


Abbildung 3-14 Sperren der Drucktasten

Ändern der autom. Ausschaltung und der Hintergrundlicht-Zeitschaltung

Die autom. Ausschaltung (Siehe Seite 22) und das Hintergrundlicht (Siehe Seite 23) werden über Zeitschaltungen gesteuert, um festzulegen, wann das Hintergrundlicht bzw. das LCR-Messgerät automatisch ausgeschaltet werden.

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
APo	(01 bis 99) Minuten oder oFF	05 Minuten
bLt	(01 bis 99) Sekunden oder oFF	30 Sekunden

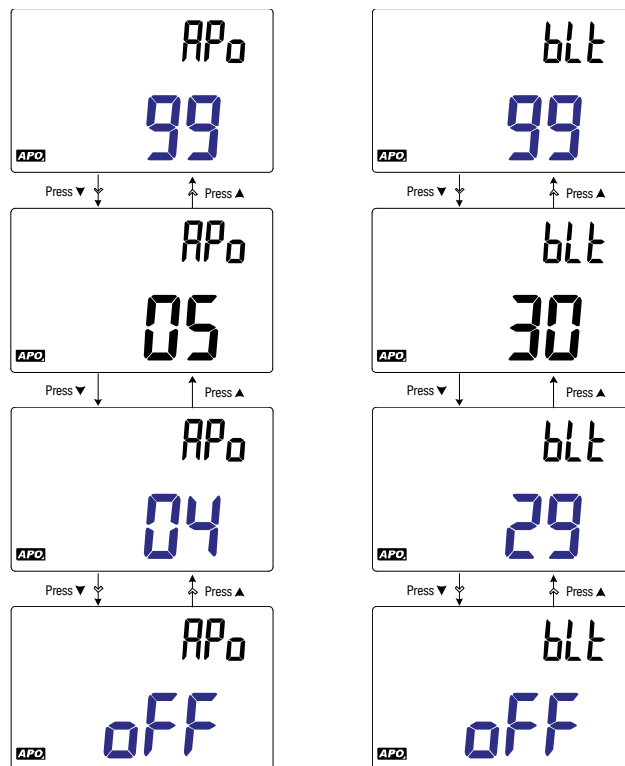



Abbildung 3-15 Ändern der autom. Ausschaltung und der Hintergrundlicht-Zeitschaltung

Zurücksetzen der Setup-Elemente

Die Setup-Elemente können über dieses Setup-Element auf die Standardwerte zurückgesetzt werden.

Drücken Sie auf , um die Werte zurückzusetzen. Das LCR-Messgerät gibt 1 akustisches Signal aus. Beenden Sie das Setup-Menü und kehren Sie in den normalen Betriebsmodus zurück.

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
rSt	dEFA	dEFA

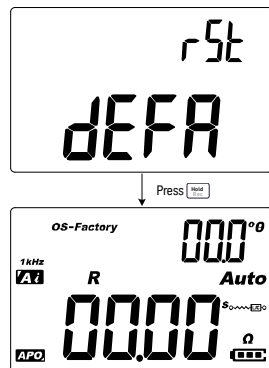


Abbildung 3-16 Zurücksetzen der Setup-Elemente

4 Eigenschaften und Spezifikationen

Eigenschaften und Spezifikationen des Handheld-LCR-Messgerät U1731C/
U1732C/U1733C finden Sie auf dem Datenblatt unter
<http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-7778EN.pdf>.

DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH LEER GELASSEN.

The logo for dataTec, featuring the word "dataTec" in a white, italicized, sans-serif font on a red rectangular background.

dataTec

Mess- und Prüftechnik. Die Experten.

**Ihr Ansprechpartner /
Your Partner:**

dataTec AG

E-Mail: info@datatec.eu

>>> www.datatec.eu

The logo for Keysight Technologies, featuring a red stylized waveform icon to the left of the text "KEYSIGHT TECHNOLOGIES" in a bold, sans-serif font.

**KEYSIGHT
TECHNOLOGIES**

Premium Plus Distribution Partner

Die in diesem Handbuch
enthaltenen Informationen können
jederzeit ohne Vorankündigung
geändert werden. Die aktuelle
Version ist stets die englische
Version auf der Keysight Website.

© Keysight Technologies 2011–2017
Auflage 7, 1. Juli 2017

Gedruckt in Malaysia



U1731-90078

www.keysight.com